


เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/ ๑๖๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕


จังหวัดนครปฐม ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ จาก บริษัท พีทูพีเฮลท์ แคร่ จำกัด ดังรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ประกอบด้วยเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้


ผนวก ๑	รายการพัสดุและราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ หน้า
ผนวก ๒	ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ หน้า
	ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ หน้า
ผนวก ๓	รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๒ หน้า
ผนวก ๔	แค็ตตาล็อก	จำนวน ๓๐ หน้า
ผนวก ๕	สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ หน้า

(ลงชื่อ).....  ผู้จะซื้อ
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

(ลงชื่อ).....  ผู้จะขาย
(นางสาวนภวรรณ อุดมวิหะชาดา)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางสาวนัตยา พละพลีวัลย์)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางสาวจำเนียร โพธิ์จินดา)

ผนวก ๑ รายการพัสดุและราคาต่อหน่วย
แนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เลขที่ นฐ๐๐๓๓/ ๑๖๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน (เส้น)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	ลวดนำทางชนิดปลายนิ่ม (JAGWIRE.๐๓๕"/๔๕๐ CM.)	๑๐๐	ร้อยละ ๗	๔,๘๘๙.๕๓	๔๘๘,๙๕๓.๐๐
๒	บอลลูนลากนิ้ว (BALLON EXTRACTOR PRO XL ๑๒-๑๕ MM.)	๑๐๐	ร้อยละ ๗	๔,๓๐๐.๓๓	๔๓๐,๐๓๓.๐๐
๓	สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี (ULTRATOME XL)	๑๐๐	ร้อยละ ๗	๔,๘๘๙.๕๓	๔๘๘,๙๕๓.๐๐
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)					๑,๔๐๗,๙๓๙.๐๐

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ข้าพเจ้า บริษัท พีทูพีเฮลท์แคร์ จำกัด เลขที่ ๒๑/๒๖๔ ตรอก/ซอย บรมราชชนนี ๑๑๕/๑
แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๖๔๕๑๕๗๘๖๙ โดย นางสาวอรุณภรณ์ อนุชาติ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ
ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๗๐/๒๕๖๕
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	วัสดุการแพทย์	-	-	๓ รายการ	๑,๔๐๙,๙๓๙.๐๐	๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑,๔๐๙,๙๓๙.๐๐	

(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด
ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ จังหวัด
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-
bidding ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕

ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบ
หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด
และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ จังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก
แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา
ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด
ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัด ลงนามให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกคืนเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ -
เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทสัญชาติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล
หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด
ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอรุณภรณ์
อนุชาติ)
ผู้รับมอบอำนาจ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6507160006063

รหัสอ้างอิง OTP UKLq

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๒๐๙๐๔๐๕

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒.ลงชื่อ.....กรรมการ 2/2
๓.ลงชื่อ.....กรรมการ



บริษัท พีทูพีเฮลท์แคร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 21/264 ซอยบรมราชชนนี 115/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2405-4863 และประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 62090 40 5

ใบเสนอราคา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลนครปฐม

บริษัท พีทูพีเฮลท์แคร์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคามาเพื่อพิจารณาดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย รวม VAT	ราคารวมเงินรวม VAT	ผลิตโดย / ประเทศ
1	ลวดนำทางชนิดปลายนิ่ม (JAGWIRE .035"/450CM)	100 เส้น	4,899.53	489,953.00	
2	บอลลูนลากนิ้ว (BALLOON EXTRACTOR PRO XL 12-15 MM)	100 เส้น	4,300.33	430,033.00	
3	สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี (ULTRATOME XL)	100 เส้น	4,899.53	489,953.00	
		ราคาสินค้า		1,317,700.00	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		92,239.00	
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		1,409,939.00	

(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

กำหนดขึ้นราคา 365 วัน

กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่านในเร็ววันนี้ และขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีทูพีเฮลท์แคร์ จำกัด

A.

(นางสาวอรุณภรณ์ อนุชาติ)

ผู้รับมอบอำนาจ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ



บริษัท พีทูพีเฮลท์แคร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 21/264 ซอยบรมราชชนนี 115/1 แขวงสาละวันธรรมสวนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2405-4863 และประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 62090 40 5

รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ลวดนำทางชนิดปลายนิ่ม (JAGWIRE 0.035"/450CM)

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 แกนกลางของลวดนำทาง ทำจากวัสดุพิเศษ คงทนต่อการหักงอ (Kink Resistant shaft) ระดับความแข็ง มีให้เลือกทั้งแบบปกติ (Standard) และ แบบแข็งพิเศษ (Stiff Shaft)
- 1.2 ลวดนำทางมีสองแถบสี เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นขณะเคลื่อนที่
- 1.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.035 นิ้ว ส่วนปลายเรียวเล็กลงเหลือ 0.027 นิ้ว ความยาว 450 ซม.
- 1.4 ส่วนปลายอย่างน้อย 5 ซม.เคลือบด้วยวัสดุพิเศษ เมื่อโดนน้ำแล้วลื่น (Hydrophilic Coating) ทำจากวัสดุ Tungsten มีความทึบรังสีสูง มีลักษณะอ่อนนุ่ม ไม่ทำอันตรายต่ออวัยวะ และสามารถมองเห็นได้ชัดจากเครื่อง X-Ray มีให้เลือกทั้งชนิดปลายตรง (Straight) และปลายโค้งงอ (Angled tip)

2. บอลลูนลากนิ้ว (BALLOON EXTRACTOR PRO XL 12-15 MM)

คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 สายขนาด 7 เฟรนช์ ส่วนปลายเรียวเล็กลงเหลือ 6 เฟรนช์ ความยาวส่วนใช้งาน (working length) 200 ซม. สามารถใช้กับลวดนำทางขนาด 0.035 นิ้ว ได้
- 2.2 ตัวสายแบ่งออกเป็น ๓ ช่อง แยกจากกัน สำหรับใส่ลวดนำทาง, ช่องสำหรับเป่าลมในบอลลูน และช่องสำหรับฉีดสารทึบรังสี ซึ่งสามารถฉีดสารทึบรังสีให้ออกได้ทั้งเหนือ (above) หรือ ใต้ (below) ต่อบอลลูน
- 2.3 สามารถขยายขนาดความกว้างของบอลลูนได้ 2 ขนาดใน 1 เส้น คือ 12-15 มม. โดยจะระบุปริมาตรลมที่ต้องใช้ไว้ที่ Pre-locked Syringe
- 2.4 ลักษณะบอลลูนเป็นทรงสี่เหลี่ยม (Squared Shoulder)

3. สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี (ULTRATOME XL)

คุณลักษณะเฉพาะ

- 3.1 ส่วนปลายสายเรียวเล็ก 5.5 เฟรนช์ ความยาวส่วนใช้งาน (working length) 200 ซม. สามารถใช้กับลวดนำทางขนาด 0.035 นิ้วได้
- 3.2 ตัวสายแบ่งออกเป็น 3 ช่องแยกจากกัน สำหรับใส่ลวดนำทาง, ฉีดสารทึบรังสี และช่องของลวดตัด
- 3.3 ความยาวเส้นลวดสำหรับตัด (Cutting Wire) มีให้เลือก 20 หรือ 30 มม.


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

A.
W



บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 21/264 ซอยบรมราชชนนี 115/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2405-4863 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 62090 40 5

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ทวีปอเมริกาหรือยุโรป
2. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

HA
A.

Jagwire™

High Performance Guidewires


Boston
Scientific

Agility and
Versatility

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

Jagwire™ High Performance Guidewires

The extended range of Jagwire high performance guidewires provides further options when performing ERCP.



Specific Tungsten-filled tip design for fluoroscopic visualisation and ductal access.

1.1 Kink-resistant shaft promotes control during advancement and support during instrument exchange.


1.2 Black and yellow pattern provides clear endoscopic visualisation – reducing the need for fluoroscopy during instrument exchange.

Non-slip proximal surface requires no special handling consideration and provides precise torque control.


Endoglide™ Coating on distal shaft promotes smooth tracking.

1.4 Tungsten-filled tip enhances fluoroscopic visualisation.**

1.4 Hydrophilic distal 5cm facilitates selective cannulation and negotiation of difficult anatomy.



RX compatible devices allow independent Jagwire control to improve selective duct cannulation.



Jagwire can be locked in place during ERCP for more secure access and simplified exchange.

Insulated jacket* Guidewire may be left in place during sphincterotomy.

Ordering Information

Order Number	O.D. (in) / (mm)	1.1 Shaft Design	Taper (in) / (mm)	Length (cm)	Tip 1.4 Style
M0055656011	.025 / 0.64	Standard	.025-.020 / 0.64-0.51	450	Straight
M0055658011	.035 / 0.89	Standard	1.3 .035-.027 / 0.89-0.69	1,345	Straight
M0055659011	.035 / 0.89	Standard	.035-.027 / 0.89-0.69	450	Angled
M0055660011	.035 / 0.89	Stiff Shaft*	.035-.027 / 0.89-0.69	450	Straight
M0055661011	.035 / 0.89	Stiff Shaft*	.035-.027 / 0.89-0.69	450	Angled
M0055662011	.038 / 0.97	Stiff Shaft*	.038-.027 / 0.97-0.69	260	Straight
M00557691	.025 / 0.64	Standard	.025-.020 / 0.64-0.51	260	Straight
M00556481	.025 / 0.64	Stiff Shaft*	.025-.020 / 0.64-0.51	260	Straight
M00556491	.025 / 0.64	Stiff Shaft*	.025-.020 / 0.64-0.51	260	Angled
M00557641	.035 / 0.89	Standard	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Straight
M00557651	.035 / 0.89	Standard	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Angled
M00557661	.035 / 0.89	Stiff Shaft*	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Straight
M00557671	.035 / 0.89	Stiff Shaft*	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Angled
M00556921	.035 / 0.89	Standard Extendable	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Straight
M00556931	.035 / 0.89	Standard Extendable	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Angled
M00556941	.035 / 0.89	Stiff Shaft* Extendable	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Straight
M00556951	.035 / 0.89	Stiff Shaft* Extendable	.035-.027 / 0.89-0.69	260	Angled
Jagtail™ RX					
M00556902	.035 / 0.89	Extendable Proximal Segment		200	N/A

Clinical images courtesy of Adam Shiva, M.D., Ph.D., Medical Director of the Gastrointestinal Laboratory, Chief of Endoscopy, Digestive Disorders Center, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA

Jagwire High Performance Guidewire U.S. Patent 5,379,779 and European Patent Numbers 049265276-2, 305 and EP1714315

* Stiff shaft design provides improved support during instrument exchange ** Data on file Boston Scientific Corporation Refer to the Instructions for Use and Warnings and Cautions for complete information

European Distribution Centre – The Netherlands
T +31 35 54 67 700 F +31 45 54 67 800

European Headquarters – Paris
T +33 1 57 66 00 01 F +33 1 57 66 01 50

Argentina (Reception)
T 0550 556 2678 F +5411 4508 8517

Australia/New Zealand
T +61 2 8063 8100 F +61 2 9320 1404

Austria
T +43 1 69 810 F +43 1 62 810 60

Belgium (Reception)
T 0693 91 494 F 0693 93 243

Brazil
T +55 11 5502 2520 F +55 11 5103 2212

Canada
T +1 607 259 5601 F +1 603 676 7026

Chile
T +56 2 454 4814 F +56 2 445 4915

China – Beijing
T +86 10 6525 1558 F +86 10 6525 1505

China – Guangzhou
T +86 20 897 9791 F +86 20 897 9799

China – Shanghai
T +86 21 6141 5563 F +86 21 6141 5570

Colombia
T +57 1 675 5045 F +57 1 612 4761

Czech Republic
T +420 229 331 500 F +420 229 331 036

Denmark (Reception)
T 69 39 50 02 F 69 39 60 05

Eilat (Reception)
T 1600 847 507 F 1500 592 993

Finland
T +358 20 761 6382 F +358 20 762 8693

France
T +33 1 50 50 43 00 F +33 1 50 50 49 01

Germany (Reception)
T 06929 723090 F 06929 723219

Greece
T +30 210 9542 300 F +30 210 9542 310

Hong Kong
T +852 2560 7100 F +852 2563 5296

Hungary
T +36 1 456 30 45 F +36 1 454 51 41

India – Bangalore
T +91 80 2212 43223 F +91 80 2207 5153

India – Chennai
T +91 44 2220 1379 F +91 44 2220 0716

India – Delhi
T +91 11 4253 2222 F +91 11 2412 0039

India – Mumbai
T +91 22 4223 3165 F +91 22 4240 3189

Italy
T +39 02 60 60 26 1 F +39 02 60 60 20 3

Korea
T +82 2 3426 2121 F +82 2 3426 1236

Mexico
T +52 55 5637 63 00 F +52 55 5697 62 28

Middle East/Gulf/North Africa
T +961 1 805 410 F +961 1 805 445

The Netherlands
T +31 30 602 53 44 F +31 30 602 55 05

Norway (Reception)
T 81 01 04 04 F 81 01 01 51

Poland
T +48 22 435 14 14 F +48 22 435 14 10

Portugal
T +351 1 331 23 40 F +351 21 331 25 58

South Africa
T +27 11 810 8000 F +27 11 403 0177

South East Asia – Malaysia
T +60 3 2263 2413 F +60 3 2221 2413

South East Asia – Philippines
T +63 2 637 6391 F +63 2 637 3547

South East Asia – Singapore
T +65 6418 6600 F +65 6418 6600

South East Asia – Thailand
T +66 2 6220 150 F +66 2 6370 400

South East Europe
T +30 210 5542 300 F +30 210 5542 310

Spain
T +34 901 11 12 15 F +34 91 319 50 03

Sweden
T +46 42 2549 00 F +46 42 2549 61

Switzerland
T +41 32 676 57 05 F +41 32 676 57 01

Taiwan
T +886 2 2717 7279 F +886 2 2717 7270

Turkey
T +90 216 484 2868 F +90 216 484 2867

UK (Reception)
T 0344 609 4512 F 0344 609 4510

Uruguay
T +59 87 900 6212 F +59 83 900 6212

Venezuela
T +58 212 959 6275 F +58 212 959 5223

Boston Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com


All cited trademarks are the property of the respective owners. CAUTION: The lowest cost device may not be the best choice. Individual countries may have different regulations for use and/or labeling. Please refer to the Instructions for Use and Warnings and Cautions for the use of our products in your country. All rights reserved. PSST 1914 Printed in the UK by Gostling.

คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๒. ลงชื่อ.....
 ๓. ลงชื่อ.....

WA
A

Jagwire™
High Performance Guidewire


...Distinctively Different for
Exceptional Access and Control

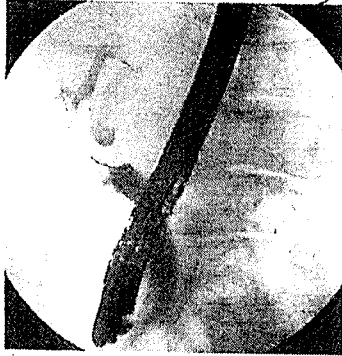

Tungsten-filled tip allows clear visualization of Jagwire Guidewire.



Hydrophilic distal segment facilitates passage beyond obstruction.

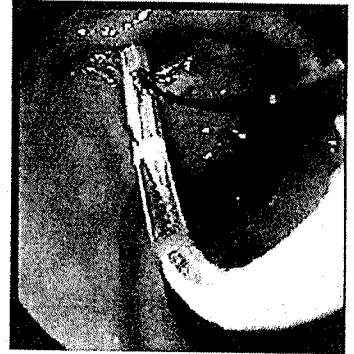

Highly visible Jagwire Guidewire may be left in place during sphincterotomy.

- 1 **Tungsten-filled Tip**
Enhances fluoroscopic visualization.
- 2 **Hydrophilic Distal Segment**
Facilitates selective cannulation and negotiation of difficult anatomy.
- 3 **Distal Endoglide™ Coating**
Promotes smooth tracking.
- 4 **Insulated Jacket**
Allows maintenance of wire position during application of electro-surgical energy.
- 5 **Kink-resistant Shaft**
Promotes excellent control during advancement and exceptional support during instrument exchange.
- 6 **Black and Yellow Pattern**
Provides clear endoscopic visualization of wire movement, reducing the need for fluoroscopy during instrument exchange.
- 7 **Non-slip Proximal Surface**
Requires no special handling consideration and provides precise torque control.
- 8 **Variety of Sizes and Designs Now Available**
Wide range of diameters, lengths, tip configurations and optional stiff shaft design meet clinical demands.

Ordering Information

Order Number	O.D. (in)	Shaft Design	Taper (in)	Length (cm)	Tip Style	Quantity Supplied
5656	.025	Standard	.025	450	Straight	Box 2
5658	.035	Standard	.035-.027	450	Straight	Box 2
5659	.035	Standard	.035-.027	450	Angled	Box 2
5660	.035	Stiff Shaft	.035-.027	450	Straight	Box 2
5661	.035	Stiff Shaft	.035-.027	450	Angled	Box 2
5662	.038	Standard	.038	260	Straight	Box 2
5663	.035	Stiff Shaft	.035-.027	260	Straight	Box 2
5664	.035	Standard	.035-.027	260	Straight	Box 2
5665	.035	Standard	.035-.027	260	Angled	Box 2
5666	.035	Stiff Shaft	.035-.027	260	Angled	Box 2

Clinical images courtesy of Adam Sliyka, M.D., Ph.D., Medical Director of the Gastrointestinal Laboratory, Chief of Endoscopy, Digestive Disorders Center, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
Jagwire High Performance Guidewire U.S. Patent No. 5,379,779
and European Patent No. EP714,315A

Nothing's out of **REACH**

Boston Scientific
MICROVASIVE®

Boston Scientific Corporation
www.bscl.com

Ordering Information
Asia Pacific Tel: 65-271-2248 x153
Fax: 65-272-6053
Canada Tel: 905-501-0350
Fax: 905-501-0440
Latin America Tel: 541-856-5855
Fax: 541-856-0575
Middle East Tel: 961-1-804706
Fax: 961-1-807152
USA Tel: 800-272-3737

Asia Pacific Headquarters
Boston Scientific Asia Pacific Pte. Ltd.
No 1 Boon Leat Terrace
Harcours de Industrial Building 1
Singapore, 119843

Latin America Headquarters
Boston Scientific Argentina S.A.
Vera 745
Buenos Aires
Argentina, 1414

Middle East Headquarters
Boston Scientific Middle East
Raouche, Shams Bldg., 1st Floor
P.O. Box 113-5369
Beirut-Lebanon

Canada Headquarters
Boston Scientific Ltd.
350 Traders Blvd. E.
Mississauga, Ontario
Canada, L4Z 1W7

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ


W
A

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

Boston
Scientific

Extractor™ Pro

XL and DL Retrieval Balloons

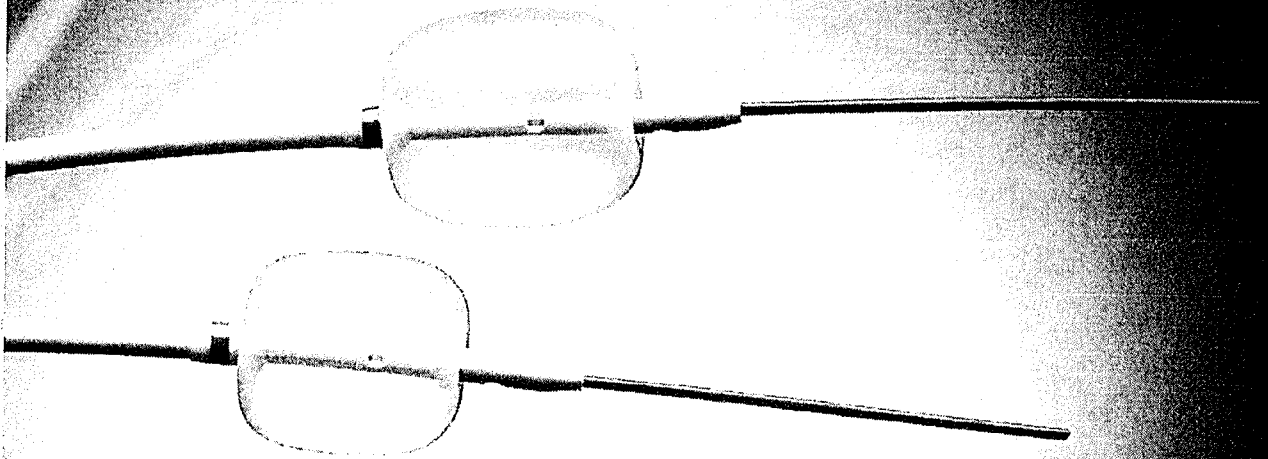

คณะกรรมาธิการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒๐


๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ A.

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

Extractor™ Pro

XL and DL Retrieval Balloons

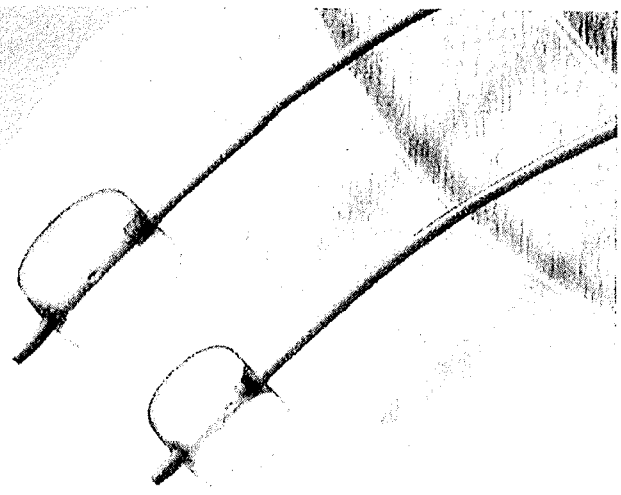


The Extractor Pro XL and DL Retrieval Balloons have been redesigned to offer long-wire users additional device options and a stiffer catheter for improved "pushability."

Enhanced Balloon Design

- New and improved balloon is designed to improve strength and reliability.
- 2.3 ➤ Each of the three balloon sizes can be inflated to two distinct diameters: 9–12mm; 12–15mm; 15–18mm to better accommodate anatomical variations and help obviate the need to use an additional balloon and change catheters if an alternative balloon diameter is required.
- 2.4 ➤ "Squared shoulder" balloon is designed to facilitate stone removal.

Improved Catheter Design

- Catheter is designed to be easily back loaded over a guidewire.
- XL catheter enables front or back loading of guidewire and offers injection-above or injection-below options to support physician preference and facilitate procedural needs.
- Designed for excellent injection flow rate.



Ordering Information

Extractor Pro XL Triple-lumen Retrieval Balloon

Order Number	Balloon (s) (mm)	Inflation	Guidewire (mm)
M00547100	9–12	Above	7–6 / 2.33–2
M00547110	2.3 12–15	Above	7–6 / 2.33–2
M00547120	15–18	Above	7–6 / 2.33–2
M00547130	9–12	Below	7–6 / 2.33–2
M00547140	12–15	Below	7–6 / 2.33–2
M00547150	15–18	Below	7–6 / 2.33–2

Extractor Pro DL Double-lumen Retrieval Balloon

Order Number	Balloon (s) (mm)	Inflation	Guidewire (mm)
M00547200	9–12	N/A	7–6 / 2.33–2
M00547210	12–15	N/A	7–6 / 2.33–2
M00547220	15–18	N/A	7–6 / 2.33–2

Packaged one per box

Packaged one per box

- 2.1 Recommended guidewire: .035" (0.89mm) Dreamwire™ High-Performance Guidewire. System length is 200cm.

European Distribution Centre – The Netherlands
T: +31 45 51 61 700 F: +31 45 51 07 030
European Headquarters – Paris
T: +33 1 37 45 60 00 F: +33 1 57 45 84 59
Argentina (FreePhone)
T: 0800 535 2978 F: +54 11 4891 4517
Australia/New Zealand
T: +61 2 8263 8100 F: +61 2 9329 1404
Austria
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60
Belgium (FreePhone)
T: 0800 94 424 F: 0200 93 043
Brazil
T: +55 11 5592 8500 F: +55 11 5193 2212
Canada
T: +1 855 350 9631 F: +1 630 975 7366
Chile
T: +56 2 445 4504 F: +56 2 445 4315
China – Beijing
T: +86 10 8515 5533 F: +86 10 8525 1556
China – Guangzhou
T: +86 20 8787 9731 F: +86 20 8787 9769
China – Shanghai
T: +86 21 6141 5359 F: +86 21 6141 5302

Colombia
T: +57 1 629 5035 F: +57 1 617 4261
Czech Republic
T: +420 258 231 901 F: +420 258 331 925
Denmark (FreePhone)
T: 80 30 63 02 F: 80 30 63 06
Eire (FreePhone)
T: 1500 822 559 F: 1600 692 558
Finland
T: +358 20 752 6532 F: +358 20 757 6583
France
T: +33 1 39 50 49 00 F: +33 1 39 30 49 00
Germany (FreePhone)
T: 0800 723 359 F: 050 10 723 319
Greece
T: +30 210 9512 305 F: +30 210 9512 319
Hong Kong
T: +852 2900 7100 F: +852 2193 5276
Hungary
T: +36 1 459 30 40 F: +36 1 456 30 41
India – Bangalore
T: +91 80 2212 4922/9 F: +91 80 2207 5153
India – Chennai
T: +91 44 2220 1879 F: +91 11 2220 0715
India – Delhi
T: +91 11 4243 2227 F: +91 11 2610 0509

India – Mumbai
T: +91 22 4230 9365 F: +91 22 4230 9139
Italy
T: +39 02 6067 001 F: +39 02 6070 2600
Korea
T: +82 2 2419 2121 F: +82 2 2425 1726
Mexico
T: +52 55 5897 03 90 F: +52 55 5897 60 28
Middle East/Gulf/North Africa
T: +961 1 825 410 F: +961 1 805 441
The Netherlands
T: +31 30 622 05 04 F: +31 30 692 55 05
Norway (FreePhone)
T: 800 104 04 F: 600 101 93
Poland
T: +48 22 425 14 14 F: +48 22 425 14 16
Portugal
T: +351 1 331 25 40 F: +351 21 391 25 53
South Africa
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6277
South East Asia – Malaysia
T: +60 3 2253 3913 F: +60 3 2283 0813
South East Asia – Philippines
T: +63 2 657 6524 F: +63 2 657 3547
South East Asia – Singapore
T: +65 6418 6223 F: +65 6416 6599

South East Asia – Thailand
T: +66 2 6350 100 F: +66 2 6329 450
South East Europe
T: +30 210 5542 350 F: +30 210 5542 310
Spain
T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 59 03
Sweden
T: +46 42 25 61 60 F: +46 42 25 69 60
Switzerland
T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01
Taiwan
T: +886 2 2717 7278 F: +886 2 2717 7270
Turkey
T: +90 216 461 35 65 F: +90 216 461 35 67
UK (FreePhone)
T: 0844 659 4517 F: 0344 030 4513
Uruguay
T: +59 82 600 6212 F: +59 82 900 6212
Venezuela
T: +53 212 933 6275 F: +53 212 659 6223

Boston Scientific

Defining tomorrow, today.™

www.bostonscientific-international.com

All Boston Scientific is a property of the respective country. CAUTION: The use of these devices to be used on the order of a physician. Boston Scientific is not responsible for the use of these devices in countries where they are not approved for use. © 2011 Boston Scientific. PSST 6522 Printed in the UK by Gosling.

คณะกรรมาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....


๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....

© 2011 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved. DINEND2271EA

Biliary


STONE RETRIEVAL

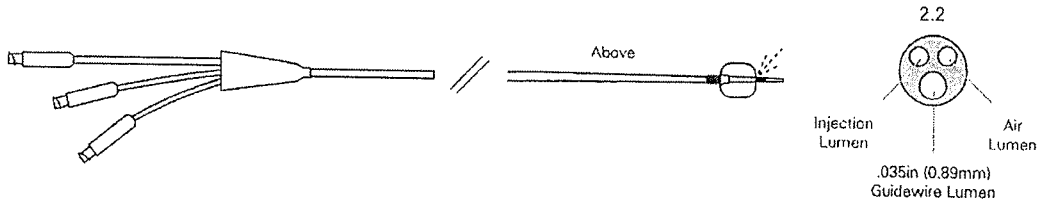

Extractor™ Pro XL Triple-lumen Retrieval Balloons – Distal Injection

Order Number	Description	Balloon Inflated (mm)	2:2 Ratio	Gr. Above (mm) (L1/L2/L3)	System Length (mm)
M00547100	Extractor Pro XL Triple-lumen Retrieval Balloon	9.0-12.0	Above	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547110	Extractor Pro XL Triple-lumen Retrieval Balloon	12.0-15.0	Above	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547120	Extractor Pro XL Triple-lumen Retrieval Balloon	15.0-18.0	Above	7-6 / 2.33-2.00	200


Packaged one per box
Recommended Guidewire: .035in (0.89mm) Dreamwire™ High Performance Guidewire

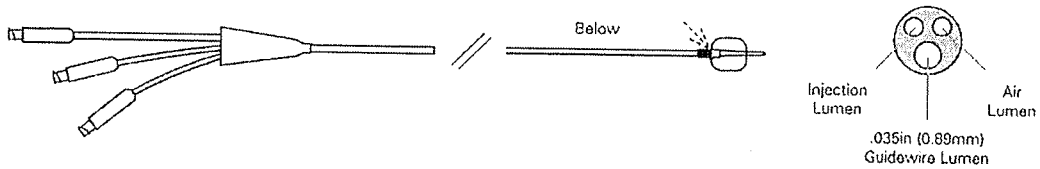

Extractor™ Pro XL Triple-lumen Retrieval Balloons – Proximal Injection

Order Number	Description	Balloon Inflated (mm)	2:2 Ratio	Gr. Above (mm) (L1/L2/L3)	System Length (mm)
M00547130	Extractor Pro XL Triple-lumen Retrieval Balloon	9.0-12.0	Below	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547140	Extractor Pro XL Triple-lumen Retrieval Balloon	12.0-15.0	Below	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547150	Extractor Pro XL Triple-lumen Retrieval Balloon	15.0-18.0	Below	7-6 / 2.33-2.00	200

Packaged one per box
Recommended Guidewire: .035in (0.89mm) Dreamwire™ High Performance Guidewire

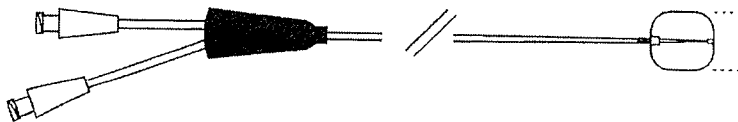

Extractor™ Pro DL Double-lumen Retrieval Balloons

Order Number	Description	Balloon Inflated (mm)	2:2 Ratio	Gr. Above (mm) (L1/L2)	System Length (mm)
M00547200	Extractor Pro DL Double-lumen Retrieval Balloon	9.0-12.0	N/A	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547210	Extractor Pro DL Double-lumen Retrieval Balloon	12.0-15.0	N/A	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547220	Extractor Pro DL Double-lumen Retrieval Balloon	15.0-18.0	N/A	7-6 / 2.33-2.00	200

Packaged one per box
Recommended Guidewire: .035in (0.89mm) Dreamwire™ High Performance Guidewire


Biliary System
Biliary
Sphincter
ERCP
Stents
Bileafix
Guidewires
Hemostasis
Polyurethane
Biopsy
Biliary
Biliary

035

ULTRATOME™ XL

TRIPLE LUMEN SPHINCTEROTOME

New Improved Distal Profile

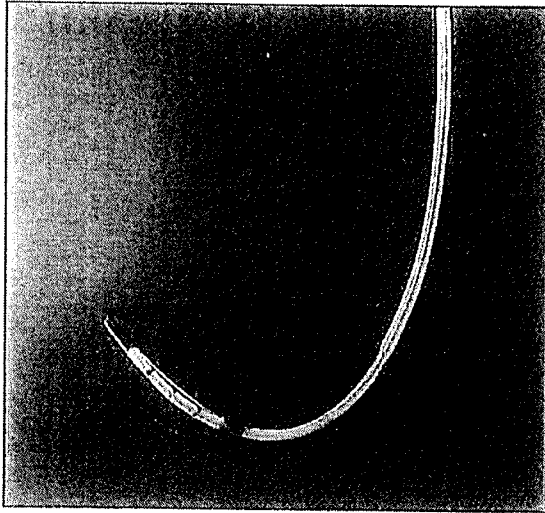

- ▶ **Improved Distal Profile**
Provides improved tip orientation
- ▶ **Off-center Cut Wire Lumen**
Facilitates cut wire positioning
- ▶ **Low Profile, Radiopaque Distal Tip**
 - Promotes atraumatic cannulation of the papilla
 - Provides excellent fluoroscopic visualization for accurate placement

New Product Bulletin

▶ **Efficient Cannulation**

The new distal profile of the Ultratome XL Triple Lumen Sphincterotome provides improved orientation of the tip upon exit from the scope. This promotes efficient cannulation of the common bile duct and correct cut wire positioning for sphincterotomy.



Ultratome XL Sphincterotome

Image courtesy of Ram Chuttani, M.D., Beth Israel Hospital, Boston, MA

Complete ordering information on reverse side

Microvasive
Boston Scientific Corporation

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ


๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

A.V.P.




ULTRATOME™ XL

TRIPLE LUMEN SPHINCTEROTOME

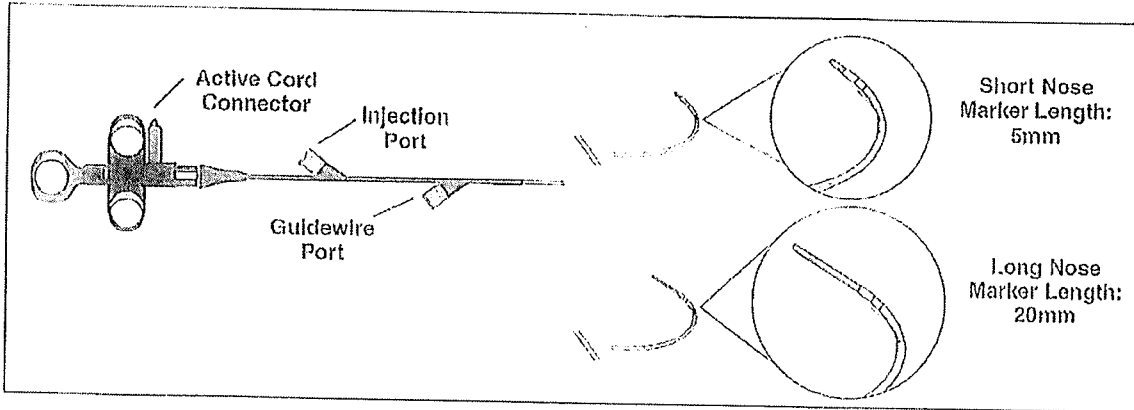

3.2

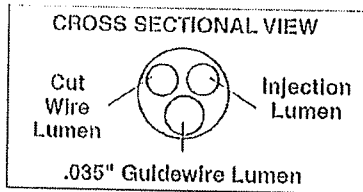

Triple Lumen Design

- Provides contrast flow with minimal bubbles for excellent opacification
- Provides dedicated injection lumen, simplifying injection even with the guidewire in place
- Provides a contrast-free guidewire surface for smooth, efficient product exchange

ORDERING INFORMATION / CALL 800-225-3226

Order Number	Distal O.D. (Fr) (mm)		Usable Length (cm)	Cut Wire Length (mm)	Tip Style	Catheter Style	Distal Marker Length (mm)	Recommended* Guidewire (in)	Quantity Supplied		
	3.3	3.3									
3590	5.5	1.8	200	20	Short Nose	Contoured	5	.035	1 ea		
3591	5.5	1.8	200	20	Long Nose	Contoured	20	.035	1 ea		
3592	3.1	5.5	1.8	3.1	200	30	Short Nose	Contoured	5	.035	1 ea
3593	5.5	1.8	200	30	Long Nose	Contoured	20	.035	1 ea		

3.1 *Recommended Guidewire .035" Zebra® Exchange Guidewire, Order #5168

Ultratome XL Patent Pending

Zebra Exchange Guidewire U.S. Patent 5,379,779

Boston Scientific Corporation

Asia Pacific Headquarters Boston Scientific Asia Pacific Pte Ltd No. 1 Boon Leat Terrace Singapore 119843 Tel: 65-271-2248	Korea Tel: 882-3476-2121	Hong Kong Tel: 852-2563-1227	Taiwan Tel: 8862-747-7278	Australia Tel: 612-9316-4444	Beijing Tel: 8610-6407-9591	Philippines Tel: 632-821-1942
	India Tel: 91-22-886-4184	Malaysia Tel: 0203-724-1306	Thailand Tel: 662-636-1971	New Zealand Tel: 64-9-366-7790	Singapore Tel: 8621-6467-1884	Indonesia Tel: 6621-0816-849941

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

A. 182



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....*คุณ.....*.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....*คุณ รพีพร*.....กรรมการ *hr*
 ๓.ลงชื่อ *อารักษ์ งามยิ่งวัฒน์*.....กรรมการ