



CALIBRATION CERTIFICATE

CUSTOMER : Linde (Thailand) Public Company Limited.
 15th Floor, Bangna Tower 2/3 Moo 14
 Bangna-Trad Road Km 6.5 Bang Kaeo Subdistrict
 Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand

CERTIFICATE No. : FLS-LAB3-21-0812
 DATE OF RECEIVED : 6-Oct-2021
 DATE OF CALIBRATION : 12-Oct-2021

UNIT UNDER CALIBRATION RESULT :

The results of unit under calibration was found accurate as show on date and place of calibration only which is valid exclusively for calibrated meter as mentioned in certificate.

Condition As-Received : Used Flow Meter New Flow Meter
 Requirement to : Without Adjustment With Adjustment

AS FOUND CALIBRATION

K-factor = 237.202 Pulse/Gallon

Calibration @ point	% Flowrate of Calibration	Flowrate : gallon/min		Error *	Repeat	Uncertainty
		Unit Under Calibration	Reference Standard			
1	25.02	24.12990	24.45565	-1.332	0.039	0.058
2	33.73	32.53625	32.97321	-1.325	0.052	0.058
3	41.80	40.32557	40.85696	-1.301	0.057	0.058
4	51.63	49.80740	50.46552	-1.304	0.061	0.058
5	61.01	58.85929	59.63346	-1.298	0.057	0.058
6	66.37	64.05988	64.87208	-1.252	0.060	0.058
7	78.12	75.36437	76.35446	-1.297	0.038	0.058
8	89.40	86.29367	87.38591	-1.250	0.048	0.058
9	98.39	94.92419	96.16925	-1.295	0.027	0.058
10	99.94	96.43162	97.68561	-1.285	0.008	0.058

AS LEFT CALIBRATION

Calibration @ point	% Flowrate of Calibration	Flowrate : gallon/min		Error *	Repeat	Uncertainty
		Unit Under Calibration	Reference Standard			

Reference Temp = 15 Deg C

$$* \% \text{ Error} = \frac{|(\text{UUC flowrate} - \text{Reference Standard flowrate}) / \text{Reference Standard flowrate}| \times 100$$

Note : Maximum permissible : Error = ± 1.00 %
 Repeatability = ± 0.10 %


The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence of approximately 95%.


CALIBRATED BY : *Pornphattha Setwong*
 PORNPHATTHA SETWONG (Technician)
 LATTAPAN KAMJING (Technician)
 SIRIRAT BUNYABORVORNWIWAT (Engineer)

This certification may not be reproduced other than in full, except with prior written approval of the issuing laboratory of Flowlab & Service Co., Ltd.

88/8 Rayong-Road 3191, Map Ta Phut, Muang District, Rayong Province 21150 Thailand Tel. +66(0)9-6302-6838, +66(0)9-8885-6317
 Fax. +66(0) 3891-5075 www.flowlabservice.co.th E-Mail Address : marketing@flowlabservice.co.th

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ






FLOW METER
CALIBRATION SHEET

Doc. NO. MS-001
Date 29/09/2000
Iss. Rev. 001

TANKER NO. TR-18		DATE 12/5/2022					
STANDARD REFERENCE AS1 PROVER Model SY-14B		SENSOR SN 54810 ELECTRONIC SN 45229					
MODEL ACE		ACCEPTANCE ERROR 0.5%					
SERIAL NO. Sensor	49026	Electronic	710355				
CALIBRATOR		CHECK		CALIBRATION		ERROR	
ACTUAL INPUT	REFERENCE	INCREMENT	DECREMENT	INCREMENT	DECREMENT	INCREMENT	DECREMENT
234.17	233.53	-	-0.64	-	-	-	0.28%
REMARKS							
CALIBRATED BY		DATE		12/5/22			
APPROVED BY		DATE					



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....
 ๒.ลงชื่อ.....
 ๓.ลงชื่อ.....



CERTIFICATE OF INSPECTION & TEST

Before Adjustment

After Adjustment

Large empty rectangular area for inspection and test results.



Handwritten signature


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....*DM*.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....*Sub*.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....*ont*.....กรรมการ

Making our world more productive



หนังสือรับรอง

เรียน ประธานกรรมการประกวดราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า

คุณลักษณะเฉพาะ


- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องให้ความมั่นใจกับโรงพยาบาลว่าจะมีออกซิเจนเหลวจากโรงงานผลิตออกซิเจนจัดส่งให้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานผลิตออกซิเจนเหลวมีกำลังการผลิตออกซิเจนเหลวโดยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยต้องเนบหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกอบกับเอกสารประกวดราคาในวันยื่นซอง
- ๓.๕ ผู้เสนอราคามีโรงงานผลิตออกซิเจนเหลวที่ได้รับการรับรองระบบผู้บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ หน่วยงานที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจของโรงพยาบาลว่าจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการผลิตและการให้บริการได้ตลอดเวลา โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานสำเนาใบรับรองดังกล่าวประกอบกับเอกสารประกวดราคาในวันยื่นซอง
- ๓.๖ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย จากบริษัทผู้ผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ ต้องนำสำเนานี้คือใบรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิไลวรรณ ตรีลี)

ผู้แทนฝ่ายขายแก่สภากาชาดไทย




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

Making our world more productive



หนังสือรับรองกำลังการผลิตของซิเมนต์เหลว

บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ลินด์ เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแก่กิจการ
สหกรณ์ รวมกว่า 40 ปี ด้วยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์

ขอรับรองว่า ลินด์ มีโรงงานผลิตออกซิเจนเหลว (โรงงานอากาศ) มากกว่า 3 โรงงาน โดยมีกำลังการ
ผลิตออกซิเจนเหลวรวมไม่ต่ำกว่าวันละ 150,000 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอที่จะจัดส่งให้กับ โรงงานภาคใต้ได้อย่างเพียงพอ


โรงงานค่าลบ	: 50 หน้ 11 ตำบลบางไร่เขต อําเภอบ้านหมอ สระบุรี 18130 โทรศัพท์ (66) 3534-2937-9 โทรสาร (66) 3534-2933 พื้นที่ตั้งในภาคกลาง มี กำลังการผลิต 15,512,882 ลบ.ม.ต่อปี เฉลี่ย -2,501.04 ลบ.ม.ต่อวัน
โรงงานบะตาหุด	: 10 นิคมอุตสาหกรรมบะตาหุด ถนนไอ-4 ต.บะตาหุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ (66) 3868-3219-20 โทรสาร (66) 3868-3221 พื้นที่ตั้งในภาคตะวันออก มีกำลังการผลิต 27.10 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี เฉลี่ย 74,000 ลบ.ม.ต่อวัน
โรงงานบะตาหุด2	: 39 ซอย จี5 ถนนพหลโยธินแคว้นรังสรรค์ ต.หัวโพ้ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ (66) 3868-7207 พื้นที่ตั้งในภาคตะวันออก มีกำลังการผลิตรวม 72,670 ตันต่อปี คิดเป็นออกซิเจนเหลวเฉลี่ย 207,037 ลบ.ม.ต่อ วัน
โรงงานภาคใต้ใหญ่	: 212 ถนนเอเชีย ตำบลบ้านพรุ อําเภอกาบังใหญ่ สงขลา 90250 พื้นที่ตั้งใน ภาคใต้ โทรศัพท์ (66) 7421-0936 โทรสาร (66) 7421-0770 มีกำลังการผลิต รวม 43,000 ตันต่อปี คิดเป็นออกซิเจนเหลวเฉลี่ย 39,269.40 ลบ.ม.ต่อวัน

บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นางสาววิไลวรรณ ศรีภักดิ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด



Legal Entity

Name: Linde (Thailand) Public Company Limited
Sample No: L123
L123456 Sample City
Phone: +66 2 252 2222
www.linde.com

Operator of bonded equipment in bonded area


Name: Sathornchai, Chaiyachon
Name: Sathornchai
Name: Sathornchai

Legal Entity

Name: Linde (Thailand) Public Company Limited
Sample No: L123456
L123456 Sample City
Phone: +66 2 252 2222
www.linde.com

Import/Export Agent

Name: Sathornchai, Chaiyachon
Name: Sathornchai
Name: Sathornchai, Chaiyachon
Name: Sathornchai
Name: Sathornchai



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ



พ.ร.บ.
ฉบับที่ 1

พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมาย
89-1/23 (ม)

ใบเสนอการประกอบกิจการในต่างประเทศ

ที่ 11.26 / 2539 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539

บริษัท บิรียัต ไทยอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 14 ซอยเทศบาล บางแก้ว อำเภอเมือง บางกอก

บริษัท บิรียัต ไทยอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 14 ซอยเทศบาล บางแก้ว อำเภอเมือง บางกอก

ประกอบกิจการในต่างประเทศ จำนวน 89
ประเภทกิจการ: สหกรณ์การเกษตร, ใบโสรจ, กาว, วัสดุเคมีภัณฑ์, วัสดุโพลิเอสเตอร์

จำนวนเงิน 19,000.75 บาท
จำนวนหุ้น 50 หุ้น

จำนวนเงิน 19,000.75 บาท
จำนวนหุ้น 50 หุ้น

จำนวนเงิน 19,000.75 บาท
จำนวนหุ้น 50 หุ้น

- (๑) ...
- (๒) ...
- (๓) ...
- (๔) ...
- (๕) ...
- (๖) ...
- (๗) ...
- (๘) ...
- (๙) ...

๑. ...

๒. ...

๓. ...

๔. ...


๕. ...

๖. ...

๗. ...

๘. ...

๙. ...



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

คำขอปรับค่าตอบแทนในกรณีพิเศษของบุคลากร

ข้าพเจ้า นาย..... ตำแหน่ง..... ชั้น..... ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาตั้งแต่ปี..... และได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาโดยตลอด

เนื่องจากข้าพเจ้ามีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหนือกว่าบุคลากรในตำแหน่งเดียวกัน จึงขอปรับค่าตอบแทนในกรณีพิเศษ



เป็นค่าตอบแทนพิเศษ..... บาท

ตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป

ขอเสนอให้พิจารณาปรับค่าตอบแทนในกรณีพิเศษของข้าพเจ้าเป็นจำนวนเงิน..... บาท

โดยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้

1. มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหนือกว่าบุคลากรในตำแหน่งเดียวกัน
2. มีผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน
3. มีคุณลักษณะที่พิเศษกว่าบุคลากรในตำแหน่งเดียวกัน
4. มีผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน
5. มีคุณลักษณะที่พิเศษกว่าบุคลากรในตำแหน่งเดียวกัน
6. มีผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน
7. มีคุณลักษณะที่พิเศษกว่าบุคลากรในตำแหน่งเดียวกัน
8. มีผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน
9. มีคุณลักษณะที่พิเศษกว่าบุคลากรในตำแหน่งเดียวกัน
10. มีผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ


๓.ลงชื่อ.....กรรมการ




บัญชีแสดงกำไรสุทธิของบริษัท

ลำดับที่	รายละเอียดบัญชี	จำนวนเงินบาท (ตัวเลข)	จำนวนเงินบาท (ตัวอักษร)
1	กำไรสุทธิ	1,234,567	หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท
2	กำไรสุทธิ	1,234,567	หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท
3	กำไรสุทธิ	1,234,567	หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท
4	กำไรสุทธิ	1,234,567	หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท
5	กำไรสุทธิ	1,234,567	หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท
6	กำไรสุทธิ	1,234,567	หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท




 ผู้จัดการ
 บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ..........กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ..........กรรมการ

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และสภาพเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้
 - 1.1 ตั้งบรรจุก๊าซแก๊สที่เจเนอเรเตอร์, ไนโตรเจนเหลวและอาร์กอนเหลว จะต้องติดตั้งที่บนถนนหรือโดยท้องที่รั้วโปร่งล้อมรอบ มีความสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 เมตร.
 - 1.2 สามารถติดตั้งตั้งบรรจุก๊าซแก๊สที่เจเนอเรเตอร์, ไนโตรเจนเหลวและอาร์กอนเหลว ตั้งรั้วที่ว่างโดยรอบไม่ต่ำกว่า 5.00 เมตร.
 - 1.3 ตั้งบรรจุก๊าซแก๊สที่เจเนอเรเตอร์, ไนโตรเจนเหลวและอาร์กอนเหลว ที่นำมาติดตั้งต้องมีเอกสารว่าได้รับการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์จากวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 - 1.4 ก๊าซติดตั้งลิ้นปิดเปิด (Stop Valve) ที่บรรจุก๊าซแก๊สรับรั้ว (Safety Valve) กับตัวตั้งบรรจุก๊าซแก๊สที่เจเนอเรเตอร์, ไนโตรเจนเหลวและอาร์กอนเหลว เว้นแต่จะติดตั้งลิ้นปิดเปิดแบบสามทาง (Three way Valve) บนถังแก๊สรับรั้วสองชุด
 - 1.5 ความกดสถิตยปรมาณค่าความกดดันของถังบรรจุก๊าซแก๊สที่เจเนอเรเตอร์, ไนโตรเจนเหลวและอาร์กอนเหลว ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจริง โดยวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 - 1.6 ตั้งบรรจุก๊าซแก๊สที่เจเนอเรเตอร์, ไนโตรเจนเหลวและอาร์กอนเหลว ที่มีติดตั้งและใช้งานรวม 10 ปี ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถัง (hydrostatic test) และส่งไปให้ตรวจสอบอย่างถาวร 3 ปีครั้ง โดยให้วิศวกรผู้รับรั้วจากวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ลงชื่อ *[Signature]* เจ้าหน้าที

2. ผู้อนุญาตได้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / ปลี้มแต่เพียงแต่เพียง เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ข้อ (Connection) ของห้องบรรจุก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในกรณีที่มีได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมถึงสำเนาให้เก็บไปตามข้อกำหนดของ CGA (Compressed Gas Association) เช่น ฝึกคอกดของแก๊สออกซิเจนของเป็น Connection No.540 และข้อต่อของท่อไนโตรเจนต้องเป็น Connection No.580
 - 2.2 ที่และสัญลักษณ์ของห้องที่บรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่และสัญลักษณ์ด้านวิชาการของบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมตาม มอก.87 และ 59 ตามลำดับ

ลงชื่อ *[Signature]* เจ้าหน้าที




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ..... *[Signature]* ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542

ลงชื่อ











(



เจ้าหน้าที่

)

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุ ครั้งต่อไป	แรงม้า /ถงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
1.	31ธค.37	19000.75	60,000.-	-	1598	50		
2.	31ธค.47	16049.75 /24ถน	60,000.-	-	0517	025839		
3.	31ธค.52	16,049.75 /52ถน.	60,000.-	-	0557	027805		
4.	31ธค.57	16049.75 /43ถน	60,000.-	-	5131	(นายชวีก อภิชาติธรรมกุล) 46		
5.	31ธค.63	16,049.75 แรงม้า /46ถน	60,000.-	-	15425	05		
ยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๕) ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒								



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

คำสั่งที่ ๕

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่..... / กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่..... เดือน..... ปี.....

อนุญาตให้..... สัญชาติ.....

ประกอบกิจการโรงงาน..... ตั้งที่.....

คำสั่งนี้ให้ยกเลิกคำสั่ง..... และให้ใช้กฎกระทรวง..... แห่งปี.....

ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... เขต..... กรุงเทพมหานคร

หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

อำนาจ/๗๓.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วที่ขออนุญาต โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด..... วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ..... ผู้อนุญาต

คำสั่งที่.....

ที่..... / กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่..... เดือน..... ปี.....

อนุญาตให้..... สัญชาติ.....

ประกอบกิจการโรงงาน..... ตั้งที่.....

คำสั่งนี้ให้ยกเลิกคำสั่ง..... และให้ใช้กฎกระทรวง..... แห่งปี.....



ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... เขต..... กรุงเทพมหานคร

หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

อำนาจ/๗๓.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วที่ขออนุญาต โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด..... วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ..... ผู้อนุญาต



[Handwritten signature]

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.ลงชื่อ..... *[Signature]* ประธานกรรมการ
- ๒.ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
- ๓.ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ

ลำดับที่ 6

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่

1. ผู้อนุญาตใช้ที่ดินจำนวน 12 ไร่ของกรมที่ดินเขตเมืองหลวง พ.ศ. 2535 ให้
ขยายโรงงานผู้ประกอบกิจการโรงงาน และตั้งกฎบัตรเป็นเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


ลงชื่อ

เจ้าพนักงาน

2. ผู้อนุญาตใช้ที่ดินจำนวน 20 ไร่ของกรมที่ดินเขตเมืองหลวง พ.ศ. 2535 ให้ขยาย
โรงงานผู้ประกอบกิจการโรงงาน และตั้งกฎบัตรเป็นเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

เจ้าพนักงาน








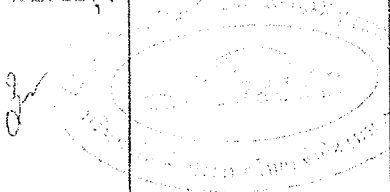
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑. ลงชื่อ..... *วิวัฒน์* ประธานกรรมการ




๒. ลงชื่อ..... *อภิ* กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... *ณ* กรรมการ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	-สิทธิเดิม 19,000.75 แรงม้า ตรวจสอบเครื่องจักรกำลังมา รวม 16,049.75 แรงม้า ต่ออายุให้เท่าที่ตรวจพบ 16,049.75 แรงม้า	
2	-แก้ไขเลขทะเบียนโรงงาน ใ้ถูกต้องเป็นทะเบียนโรงงาน เลขที่ 3-89-1/23 สม.	
3	-ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีปีที่ 1 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ.2547 ตามใบรับรองระบบการวัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004) และใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)	
4	-ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานจากเดิมชื่อ บริษัท ไทยอินคัสเกรียส แก๊ส จำกัด(มหาชน) เป็นชื่อ บริษัท อินคัส(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ตามหนังสือบริษัทฯ เลขลงวันที่ 07985 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555	
5	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนทะเบียนโรงงานใหม่ จากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-89-1/23สม เป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ 10490200125232 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่	 



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ..........กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ..........กรรมการ

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่.....

ที่...../.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 อนุญาตให้.....สัญญาติ.....
 อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ต.รอก / ซอย.....ถนน.....
 หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....
 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....
 ประกอบกิจการ.....


(กาลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน
 ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ต.รอก / ซอย.....ถนน.....
 หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....
 อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ () ผู้อนุญาต
 ครั้งที่.....

ที่...../.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 อนุญาตให้.....สัญญาติ.....
 อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ต.รอก / ซอย.....ถนน.....
 หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....
 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....
 ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน
 ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ต.รอก / ซอย.....ถนน.....
 หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....
 อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้


ลงชื่อ () ผู้อนุญาต



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี


ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องมือจัด	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เกินกำหนด	วันที่	เลขที่	
16	18ก.พ.51	1ก.พ.51	16044.75	15000	-	6715	23	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
17	18ก.พ.52	23ก.พ.52	16044.75	15000	-	6715	23	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
18	28ก.พ.53	1ก.พ.53	16044.75	15000	-	6715	23	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
19	18ก.พ.54	23ก.พ.54	16044.75	15000	-	6715	23	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
20	28ก.พ.55	1ก.พ.55	16044.75	15000	-	6715	23	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
21	28ก.พ.56	1ก.พ.56	16044.75	15000	-	6715	23	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
22	28ก.พ.57	29ก.พ.57	16044.75	15000	-	6715	27	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
23	28ก.พ.58	30ก.พ.58	16044.75	15000	-	6715	15	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
24	28ก.พ.59	31ก.พ.59	16044.75	15000	-	6715	12	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
25	28ก.พ.60	1ก.พ.60	16044.75	15000	-	6715	20	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
26	28ก.พ.61	1ก.พ.61	16044.75	15000	-	6715	20	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
27	28ก.พ.62	1ก.พ.62	16044.75	15000	-	6715	20	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
28	28ก.พ.63	1ก.พ.63	16044.75	15000	-	6715	20	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
29	28ก.พ.64	1ก.พ.64	16044.75	15000	-	6715	20	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)
30	28ก.พ.65	1ก.พ.65	16044.75	15000	-	6715	20	(นางมณฑิรา สว่างพรรค)



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....
 ๒.ลงชื่อ.....
 ๓.ลงชื่อ.....

บัญชีผลการชำระค่ารถรวมกับค่าน้ำมัน

ครั้งที่	วันที่	รับ	เลขที่เช็ค /ใบรับ	จำนวนเงิน		ใบเสร็จรับเงิน		เข้าบัญชี
				ปกติ	เบ็ดเตล็ด	ฉบับที่	วันที่	
1.	28ก.พ.36	9ก.พ.36	19,000.75	18,000	21,158.	1551	32	...
2.	28ก.พ.37	17ก.พ.37	19,000.75	18,000	7,860.	1593	11	...
3.	28ก.พ.38	21ก.พ.38	19,000.75	18,000	660.	0672	10	...
4.	28ก.พ.39	14ก.พ.39	19,000.75	18,000	450.	1520	54	...
5.	28ก.พ.40	10ก.พ.40	19,000.75	18,000				...
6.	28ก.พ.41	25ก.พ.41	19,000.75	18,000.		507	68	...
7.	28ก.พ.42	11ก.พ.42	19,000.75	18,000		1111	22	...
8.	28ก.พ.43	13ก.พ.43	19,000.75	18,000.	5,110.	1113	15	...
9.	28ก.พ.44	22ก.พ.44	19,000.75	18,000.		0571	02	...
10.	28ก.พ.45	25ก.พ.45	19,000.75	18,000.		0577	02	...
11.	28ก.พ.46	28ก.พ.46	19,000.75	18,000.		0582	02	...
12.	28ก.พ.47	1ก.พ.47	19,000.75	18,000.		0583	02	...
13.	28ก.พ.48	25ก.พ.48	19,000.75	18,000.		0586	02	...
14.	28ก.พ.49	1ก.พ.49	19,000.75	18,000.		0587	02	...
15.	28ก.พ.50	1ก.พ.50	19,000.75	18,000.		0588	02	...



Handwritten signature

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... *Handwritten signature* ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... *Handwritten signature* กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... *Handwritten signature* กรรมการ

ลำดับที่ ๑๐

ลำดับและจำนวนของเอกสาร

ลำดับที่	จำนวนหน้า									จำนวนหน้า
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

(นายสมชาย ใจดี)
ผู้อำนวยการ

๐๖



[Handwritten signature]

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ..... *[Signature]* ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ



003/

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-89-1/35 สช

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ ป. 32 / 2538

พ.ศ. ๒๕๓๘

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2538

อนุญาตให้ บริษัท เข้าเพอร์มิตวิศกวิธอักษิเณ จำกัด สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 123/1 ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง บ้านพร อำเภอ/เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

ชื่อโรงงาน บริษัท เข้าเพอร์มิตวิศกวิธอักษิเณ จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 89

ประกอบกิจการผลิตและบรรจุก๊าซอ็อกซิเจนเหลว

กำลังเครื่องจักร 693.50 แรงม้า จำนวนคนงาน 25 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 123/1 ตรอก / ซอย ถนน สายเอเชีย

หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง บ้านพร

อำเภอ/เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีการสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดเส้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |
| (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร | แสดงไว้ในลำดับที่ 10 |

(นายสุนทร จันทภาไช)

ลงชื่อ


(นายสุนทร จันทภาไช)

ผู้อนุญาต

()

ผู้ให้...

...



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

Handwritten initials

วันที่ออกให้: 10 กพ

สำนักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์
เลขที่รับ: 1665
วันที่: 26 มี.ค. 2542

คำขอออกใบโอนหุ้นจากบริษัทมหาชน

26 มี.ค. 2542

วันที่ 26 มี.ค. 2542

มีผู้ขอ: บริษัท ไทยเอ็กสโพลอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ...
ผู้โอนหุ้น: บริษัท ไทยเอ็กสโพลอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ...
ผู้รับโอนหุ้น: บริษัท ไทยเอ็กสโพลอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ...

มีอยู่ ณ วันที่ 23/2/42 ...
จำนวนหุ้น ...
มูลค่า ...

1. บริษัท ไทยเอ็กสโพลอเรชั่น จำกัด	100
2. บริษัท ไทยเอ็กสโพลอเรชั่น จำกัด	100
3. บริษัท ไทยเอ็กสโพลอเรชั่น จำกัด	100
4. บริษัท ไทยเอ็กสโพลอเรชั่น จำกัด	100
5. บริษัท ไทยเอ็กสโพลอเรชั่น จำกัด	100


Large circular stamp and signature

Unite (Thailand) Public Company Limited
บริษัท ยูนิท จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ลงชื่อ ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ กรรมการ
๓. ลงชื่อ กรรมการ


บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น




ลำดับที่	ชื่อบุคคลผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	เป็นสมาชิก
1	นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ	1000	ไม่
2	นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ	1000	ไม่

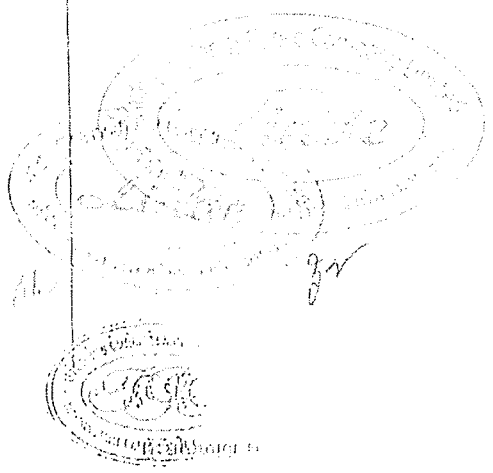

วันที่ พ.ศ.
 นาย..... กรรมการผู้จัดการ
 ผู้แทนบริษัทฯ





คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....  กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....  กรรมการ

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 สลิกัดข้อต่อสหกรรมในที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จะต้องทำสลิกัดข้อต่อนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสลิกัดข้อต่อสหกรรมที่กำหนดไว้

1.2 ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวจะต้องติดตั้งบนพื้นคอนกรีต โดยต้องมีรั้วไม่รั้งล้อมรอบมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

1.3 สถานที่ติดตั้งถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวต้องมีที่ว่างโดยรอบไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร

1.4 หัวติดตั้งลิ้นปิด (Stop Valve) กับระหว่างลิ้นปิด (Safety Valve) กับตัวถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว เว้นแต่จะติดตั้งลิ้นเปิดแบบสามทาง (Three way Valve) โดยต้องมีลิ้นปิดสองชุด

1.5 ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวที่นำมาติดตั้งต้องมีเอกสารว่าได้รับตรวจสอบรับรองความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์จากวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแล้ว

1.6 การทดสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีเอกสารรับรองจากวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกคราว


1.7 ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวที่ติดตั้งและใช้งานครบ 10 ปี ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถัง (Hydrostatic test) และนำไปให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี ครั้งละครั้งโดยมีเอกสารรับรองจากวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ลงชื่อ (นายสุภาวราภ สิริลักษณ์) เจ้าหน้าที วิศวกร อ

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.1 ข้อต่อ (connections) ของถังบรรจุก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐานสลิกัดข้อต่อสหกรรม ในกรณีซึ่งไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานสลิกัดข้อต่อสหกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ CGA (Compressed Gas Association) ให้เป็น ข้อต่อของถังออกซิเจนต้องเป็น Connection No. 540 และข้อต่อของถังไนโตรเจนต้องเป็น Connection No. 580 เป็นต้น

ลงชื่อ (นายสุนทร จันทร์หาญ) เจ้าหน้าที วิศวกร




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑. ลงชื่อ... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ... กรรมการ
๓. ลงชื่อ... กรรมการ

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข


1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้


- 1.8 ท่อบรรจุก๊าซที่มีขนาดความจุไม่เกิน 500 ลิตร ต้องได้รับการทดสอบความปลอดภัยของท่อตามมาตรฐาน (มอก. 358-2531) ชุด 1.8.1 หรือตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมจะกำหนดไว้โดยมีเอกสารรับรองจากวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมผูกพัน
- 1.9 ท่อที่ใช้บรรจุก๊าซอื่นที่อื่นต้องได้มาตรฐานตาม มอก. 359-2523
- 1.10 ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบท่อตาม มอก. 358-2531
- 1.11 ท่อที่สำหรับการทดสอบความ มอก. 2531 แล้ว จะต้องหาเครื่องหมาย ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของหน่วยทดสอบและเดือน-ปีที่ทดสอบ ลงบนท่อให้ชัดเจน
- 1.12 ต้องเก็บรักษาบันทึกการทดสอบไว้อย่างน้อย 5 ปี
- 1.13 สีของท่อที่ใช้บรรจุก๊าซต้องเป็นไปตาม มอก. 47-2517 หรือ มอก. 48-2517
- 1.14 เอกสารรับรองการตรวจทดสอบ ตามข้อ 5, 6, 7, 8 ต้องส่งให้กองความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 30 วัน หลังจากการตรวจทดสอบทุกครั้ง



ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นายสุภากรณ ศรีอักษร)
 วิศวกร 6




2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

- 2.2 สีและสัญลักษณ์ของท่อที่ใช้บรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...
 มาตรฐาน... สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมตาม มอก. 87 และ 88 ตามลำดับ


 (นายสุนทร จันทร์ทาโก)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นายสุวิทย์ ตรี นิลประเสริฐวงศ์)
 วิศวกร



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ  กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ  กรรมการ

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรคทำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ () เจ้าหน้าที่ ()

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.3 ต้องตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง และแผนงานลดความเสี่ยง) หรือจัดทำรายงานการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการที่เสนอในรายงานประเมินความเสี่ยงทุกปี โดยเก็บไว้ที่ โรงงานพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

.....
.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ ()
(นายสุนทร จันทภาโส)

ลงชื่อ () เจ้าหน้าที่ ()
(นายจิรา ทรรพ์ธินันต์) ผู้ย้ายราชการส่วนที่ ๘

Handwritten signature













คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต


1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่.....26.....เดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ.....2535.....
3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่.....31.....เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ.....2537.....

ลงชื่อ () เจ้าหน้าที




4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุ ครั้งต่อไป	แรงม้า /กงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
1	31 ธค. 42	693.59 25	18,000		0317	22		
2	31 ธค. 47	5,443.50 25	55,000	-	590	29477		
3	31 ธค. 52	5,443.50 25	55,000	-	398	19876	 (นายเทวี อภิชาติ) เจ้าหน้าที่	 นายพิชิต วิริยะโรจน์ ผู้อำนวยการโรงงาน
4	31 ธค. 57	5,443.50 25	55,000	-	4915	28	 นายสุวิทย์ ธรรมานนท์ เจ้าหน้าที่	 นายประจักษ์ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงงาน
5	1 ธค. 2563	5443.50 25	55,000	-	13708	07	 (นายชราวุธ วัฒนศิริ) เจ้าหน้าที่	 นายประจักษ์ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงงาน
6	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ ไม่มีกำหนดวันสิ้นอายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน ดังกล่าวของราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 14 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ						 นายสุวิทย์ ธรรมานนท์ เจ้าหน้าที่	 นายประจักษ์ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงงาน

โรงงาน พ.ศ.2537 ถึงวันสิ้นใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562





คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ..........กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ..........กรรมการ

ลำดับที่ 4

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่ 1

ที่ ช. 11 / ๕๖๕๑

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

อนุญาตให้ บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 89

ประกอบกิจการ แล็ดและบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว อาร์กอนเหลว และก๊าซอื่น ๆ

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น - 4,750 - แรงม้า รวมเป็น - 5,443.50 แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 212 ตรอก / ซอย ถนน สายเอเชีย

หมู่ที่ 1 คลอง แม่ท่า ตำบล / แขวง บ้านพรุ

อำเภอ / เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 270 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ลิ้มภักดี)
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้รับใช้ประจำกระทรวงให้ออกใบอนุญาต

ผู้อนุญาต

ที่ /

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ เดือน พ.ศ.

อนุญาตให้ สัญชาติ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่

ประกอบกิจการ

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น แรงม้า รวมเป็น แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ตรอก / ซอย ถนน

หมู่ที่ คลอง แม่ท่า ตำบล / แขวง


อำเภอ / เขต จังหวัด

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นายสุภทร จันทภาโส)

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ กรรมการ

๓. ลงชื่อ กรรมการ

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่.....1.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จะต้องทำผลิตภัณฑ์นั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดด้วย

1.2 ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวจะต้องติดตั้งบนพื้นคอนกรีต โดยต้องมีรั้วป้องกันรอบมที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

1.3 สถานที่ติดตั้งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวต้องมีที่ว่างโดยรอบไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร

1.4 ห้ามติดตั้งลิ้นปิดเปิด (Stop Valve) กั้นระหว่างลิ้นรั้งภัย (Safety Valve) กับตัวถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว เว้นแต่ จะติดตั้งลิ้นปิดเปิดแบบสามทาง (Three way Valve) โดยต้องมีลิ้นรั้งภัยสองชุด

1.5 ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวที่นำมาติดตั้งต้องมีเอกสารว่าได้รับการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์จากวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแล้ว

1.6 การทดสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีเอกสารรับรองจากวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกคราว

1.7 ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลวที่ติดตั้งและใช้งานครบ 10 ปี ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถัง (Hydrostatic test) และต่อไปให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี ต่อครั้งโดยมีเอกสารรับรองจาก

วิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ลงชื่อ

(นายประสงค์ เจริญศรี)
หัวหน้างาน ๑.1

เจ้าหน้าที่


1.8 ท่อบรรจุ/..

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

(นายสุนทร จันทร์กาโช)

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมก


๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่.....1.....


1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขและผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้
 - 1.8 ท่อบรรจุก๊าซที่มีขนาดความจุไม่เกิน 500 ลิตร ต้องได้รับการทดสอบความปลอดภัยของท่อความมาตรฐาน (มอก. 258-2531) ทุก ๆ 3 ปี หรือตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมจะกำหนดต่อไป โดยที่เอกสารรับรองจากวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกละระ
โดยที่เอกสารรับรองจากวิศวกรผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกละระ
 - 1.9 ท่อที่ใช้บรรจุก๊าซออกซิเจนต้องได้มาตรฐานตาม มอก. 359-2523
 - 1.10 ท่อที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบท่อตาม มอก. 358-2531
 - 1.11 ท่อที่ผ่านการทดสอบตาม มอก. 2531 แล้ว จะต้องทำเครื่องหมาย ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ของหน่วยทดสอบและเดือน-ปีที่ทดสอบ ลงบนท่อให้ชัดเจน
 - 1.12 ต้องเก็บรักษาน้ำหนักการทดสอบไว้อย่างน้อย 5 ปี
 - 1.13 สีของท่อที่ใช้บรรจุก๊าซต้องเป็นไปตาม มอก. 47-2517 หรือ มอก. 48-2517
 - 1.14 เอกสารรับรองการตรวจทดสอบ ตามข้อ 5, 6, 7, 8 ต้องส่งให้กองความปลอดภัยโรงงาน อุตสาหกรรม ภายใน 30 วัน หลังจากการตรวจทดสอบทุกครั้ง
 - 1.15 ห้ามระยมน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน

ลงชื่อ


(นายประสิทธิ์ เจริญศรี)
หัวหน้างาน อ.1


เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม-เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้


(นายสุนทร จันทกาโท)

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

ลำดับที่ ๑


การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในสาขาที่ย้าย

3-89-1/35 ตร.

ครั้งที่	แจ้งประกอบกิจการ	เริ่มประกอบกิจการ	เจ้าหน้าที่
1	23 สิงหาคม 2539	10 กันยายน 2539	นายสุวิทย์ วิริยะชัยกุล เจ้าพนักงานควบคุมโรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี









.....
 (นายสุวิทย์ วิริยะชัยกุล)







Handwritten initials 'sv'.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ..... *sv*ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ..... *sv*กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ..... *sv*กรรมการ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1.	เดิมเลขที่ 133/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปลี่ยนเป็น 212 ถนนเอเชีย ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามหนังสือรับรองของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพรุ ที่ สข 52301/813 ลงวันที่ 1 กันยายน 2538	 (นายเสกสรรค์ นงอินทร์) วิศวกรเครื่องกล
2.	ขอเพิ่มประเภทการประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์โครเจน อาร์คอบ และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งในรูปของเหลวและก๊าซเพื่อจำหน่าย ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2539	 (นายเสกสรรค์ นงอินทร์) วิศวกรเครื่องกล
3	ต่ออายุปี 2543-2547 ติดตั้งเครื่องจักร 4.873.80 แรงม้า สิทธิที่ได้รับอนุญาต 5.443.50 แรงม้า ที่เหลือ 569.70 แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์ไว้	 (นายเสกสรรค์ นงอินทร์) วิศวกรเครื่องกล
4	ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ลินเค้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามคำร้องของบริษัทฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555	 (นายเสกสรรค์ นงอินทร์) วิศวกรเครื่องกล
5	ใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานนมข้นเปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่ จากเดิมทะเบียนโรงงาน เลขที่ 3-89-1/35สข เป็นทะเบียนโรงงาน เลขที่ 10900500125355 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่	 (นายธานี ขุนสุระ) วิศวกรปฏิบัติการ
6	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ ไม่มีการทบทวนกับอายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ร.บ. 2562 มาตรา 10 ได้ยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562	 (นายธานี ขุนสุระ) วิศวกรปฏิบัติการ



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ..........กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ..........กรรมการ

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....1.....

ที่.....จ. 505 / ๔53๗..... กระทรวงอุตสาหกรรม
 วันที่..... 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 อนุญาตให้..... บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) สัญชาติ ไทย
 อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่..... 2/3..... หมู่ที่..... 14 ตำบล / แขวง..... บางแก้ว อำเภอ / เขต..... บางพลี จังหวัด..... สมุทรปราการ
 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่..... 89
 ประกอบกิจการ..... ผลิตและบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว

กำลังเครื่องจักร..... 693,50..... แรงม้า จำนวนคนงาน..... 25..... คน
 ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... 133/1..... ตรอก / ซอย..... ถนน..... สายเอเชีย
 หมู่ที่..... 1..... คลอง..... แม่น้ำ..... ตำบล / แขวง..... บ้านพร
 อำเภอ / เขต..... นาดใหญ่..... จังหวัด..... สงขลา..... ประกอบกิจการโรงงานได้


ลงชื่อ..... (นายประเสริฐ ลิ้มศักดิ์) ผู้อนุญาต
 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ได้รับมอบหมายหรืออภิอนุญาติ
 ครั้งที่.....

ที่..... /..... กระทรวงอุตสาหกรรม
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
 อนุญาตให้..... สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่..... ตรอก / ซอย..... ถนน.....
 หมู่ที่..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....
 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....
 ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร..... แรงม้า จำนวนคนงาน..... คน
 ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... ตรอก / ซอย..... ถนน.....
 หมู่ที่..... คลอง..... แม่น้ำ..... ตำบล / แขวง.....
 อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ..... (นายจันทกร จันทร์ภาโส) ผู้อนุญาต



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ