



ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ใบจดทะเบียนที่ สาน. 88/2553...

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมี นายทากาฮิโร โอซาว่า เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการของสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ชื่อ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 906-910

ตรวจ/ชอย ถนน สุขุมวิท 21

หมู่ที่ ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 2730-1

สถานที่ที่ปรึกษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 906-910

ตรวจ/ชอย ถนน สุขุมวิท 21

หมู่ที่ ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 2730-1

สถานที่ที่ปรึกษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 64/40

ตรวจ/ชอย สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง ดอกไม้ อำเภอ/เขต ประเวศ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 โทรศัพท์ 0 2727 0580

สำหรับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามเอกสารแนบท้าย

โดยมีผู้ควบคุมการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(7) ดังนี้

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการนี้เท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

(ลายมือชื่อ)


ตำแหน่ง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ ... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ ... กรรมการ

๓. ลงชื่อ ... กรรมการ

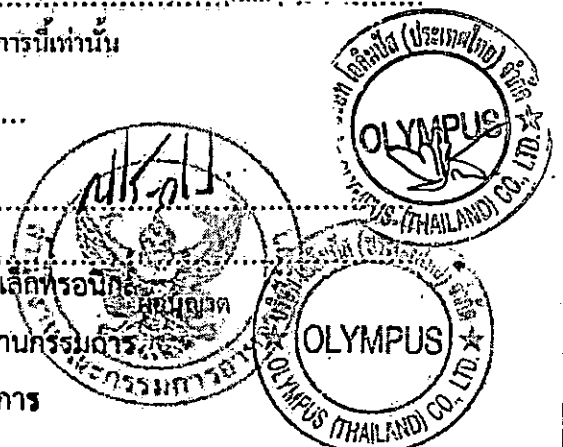

Handwritten signature or mark at the bottom right.

การต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ

การต่ออายุครั้งที่ 1

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
(ลายมือชื่อ) *[ลายมือชื่อ]*
ตำแหน่ง *[ตำแหน่ง]*
.....
.....

การต่ออายุครั้งที่ 2

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง *[ตำแหน่ง]*
.....
.....

การต่ออายุครั้งที่ 3

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง

ผู้อนุญาต

.....

การต่ออายุครั้งที่ 4


ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง

ผู้อนุญาต

.....

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑. ลงชื่อ *[ลายมือชื่อ]* ประธานกรรมการ
- ๒. ลงชื่อ *[ลายมือชื่อ]* กรรมการ
- ๓. ลงชื่อ *[ลายมือชื่อ]* กรรมการ

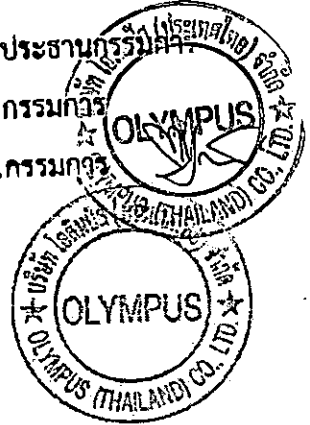


[ลายมือชื่อ]

เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ ตบ. 88/2553

ขอขยายเครื่องมือแพทย์

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Anesthesiology | 2. Bariatric Services |
| 3. Cardiothoracic Surgery | 4. Emergency Medicine |
| 5. Gastroenterology | 6. Gynecology |
| 7. Healthcare Information Technology | 8. Implants |
| 9. Intensive Care Unit | 10. Internal Medicine |
| 11. Minimally Invasive Surgery | 12. Nephrology |
| 13. Obstetrics | 14. Orthopedics |
| 15. Otolaryngology | 16. Pediatrics |
| 17. Proctology | 18. Pulmonary Medicine |
| 19. Respiratory Care Services | 20. Surgery |
| 21. Urology | |


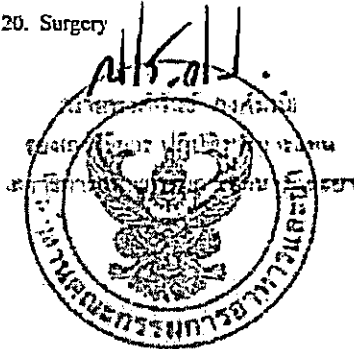


รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2556



อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนสถานประกอบการ ดังนี้

- ยกเลิกห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ ห้องที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 1
- เพิ่มสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้องเลขที่ 916 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- เปลี่ยนผู้ดำเนินการจาก นายทากาอิโร่ โอซาวา เป็น นายอากิโอะ มิโตโมะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มี.ค. 2556 เป็นต้นไป

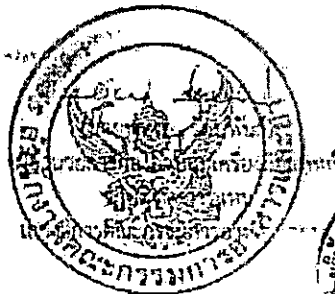

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ

Handwritten signature

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2557

อนุญาตให้ย้ายสถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ จากเดิมเลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทราวอร์ ชั้น 9 ห้องเลขที่ 906-910 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2260 2730 โทรสาร 0 2260 6600

เป็นเลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 32-33 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2000 7700 โทรสาร 0 2000 7711


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป



รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2558

อนุญาตให้เพิ่มสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 114/7 ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป

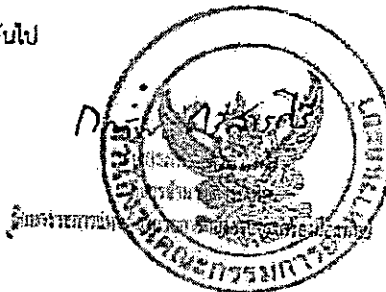

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2559




อนุญาตให้เปลี่ยนผู้ดำเนินการจาก นายอากิโอะ มิโตะโมะ เป็น นายอากิโอะ โคบายาชิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป



- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ๑. ลงชื่อ..... *ศิริฉวี จันทิวงษา* ประธานกรรมการ
 - ๒. ลงชื่อ..... *น. ส. น.* กรรมการ
 - ๓. ลงชื่อ..... *one* กรรมการ



one

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2559

อนุญาตให้เพิ่มสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 567/20, 567/21 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป




รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2559

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการ ดังนี้

1. ยกเลิกสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 2
2. เพิ่มสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยสุชาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 มีจำนวน 3 ห้อง ชั้นที่ 1 จำนวน 2 ห้อง ชั้นที่ 3 จำนวน 1 ห้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป

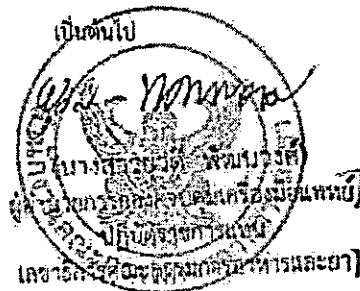

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังของสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยสุชาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยเพิ่มห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์บริเวณชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 ของที่ตั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดรางวัลลูกโลกทองคำ

๑. ลงชื่อ..... ศิวภค วิเศษานนท์..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... [Signature]..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... [Signature]..... กรรมการ




[Signature]

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560

อนุญาตให้เพิ่มสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 27 ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561

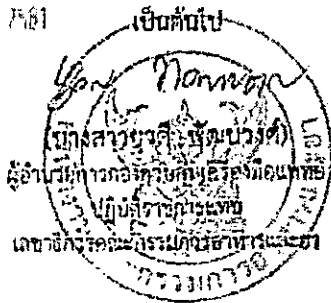

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ จากเลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 32-33 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2000 7700 โทรสาร 0 2000 7711

เป็นเลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2000 7700 โทรสาร 0 2000 7711


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2561



รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

อนุญาตให้เพิ่มห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ในสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยสุขุมภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 บริเวณชั้นที่ 4 จำนวน 3 ห้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2561




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดรางวัลเลิศทรอณิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ



รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

อนุญาตให้ย้ายสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 5 จากเลขที่ 567/20, 567/21 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เป็นเลขที่ 456 อาคารซี ห้องเลขที่ 1-2 หมู่ที่ 23 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4300 0270

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป



รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังภายในของสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 32 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2000 7700 โดยปรับเปลี่ยนตำแหน่งของห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์และมีห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์จำนวน 2 ห้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... คุณศรี จงพิทักษ์ ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... ป.ชัย กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... อ.นร กรรมการ

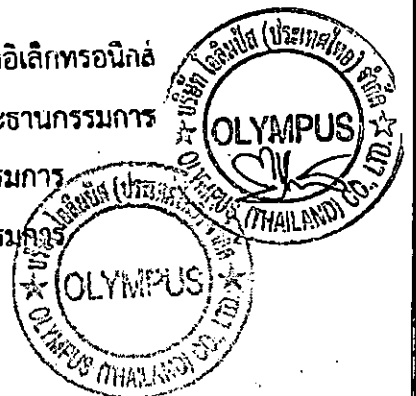

Handwritten signature


รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ดังนี้
อนุญาตให้ยกเลิกห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ห้องที่ 1 โดยคงเหลือห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ ห้องที่ 2 จำนวน 1 ห้อง ในสถานที่เก็บ
รักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 1 เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่


1-3 ก.ย. 2562

เป็นต้นไป

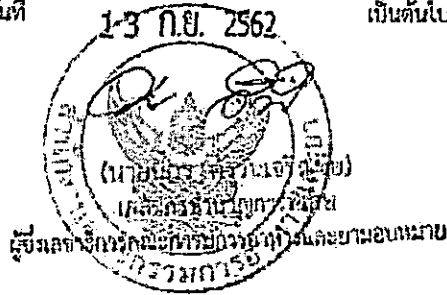

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... *ศิริมาลี จงษ์พิบูล* ประธานกรรมการ (ประเทศไทย)
๒. ลงชื่อ..... *ก. อ. น.* กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... *อน* กรรมการ

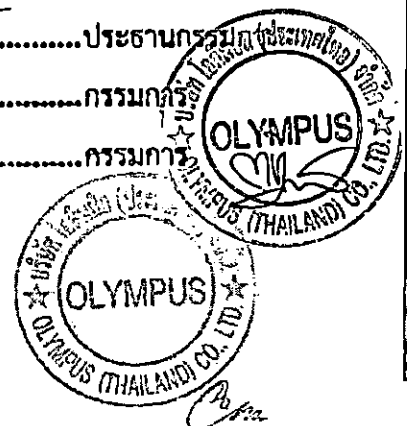

เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553

ขอขยายเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า

รายการเครื่องมือแพทย์ในขอขยายเดิม จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่

1. Anesthesiology

1.1 Suction Kits

UMDN Code 13846

2. Gastroenterology

2.1 Balloons, Gastric, Appetite-Suppressing

UMDN Code 17202

2.2 Colonoscopes, Video

UMDN Code 17665

2.3 Forceps, Biopsy, Flexible Endoscopic

UMDN Code 16268

2.4 Forceps, Biopsy, Rigid Endoscopic

UMDN Code 16269


2.5 Forceps, Biopsy, Other

UMDN Code 16270

2.6 Duodenoscopes


UMDN Code 11359


ขอรับรองว่าเป็นความจริง


ลงชื่อ  ผู้ดำเนินกิจการ
(นายอิจาโอะ โทบายาชิ)




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....  กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....  กรรมการ




เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553

ขอบข่ายเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า

2.7 Gastroscopes	UMDN Code 11856
2.8 Forceps, Grasping, Flexible Endoscopic	UMDN Code 15628
2.9 Laparoscopes, Video	UMDN Code 18087
2.10 Ureteroscopes	UMDN Code 15788
2.11 Light Sources, Fiberoptic, Rigid Endoscopic/Multipurpose	UMDN Code 16831
2.12 Stents, Biliary	UMDN Code 17672
3. Gynecology	
3.1 Stents	UMDN Code 15784
4. Obstetrics	
4.1 Cannulae, Uterine	UMDN Code 10580
5. Orthopedics	
5.1 Arthroscopes	UMDN Code 10198
6. Otolaryngology	
6.1 Laryngoscopes	UMDN Code 12293
7. Pulmonary Medicine	
7.1 Bronchoscopes	UMDN Code 10491
7.2 Bronchoscopes, Flexible	UMDN Code 15073
7.3 Bronchoscopes, Flexible Video	UMDN Code 17662
8. Surgery	
8.1 Biopsy Kits	UMDN Code 10401
8.2 Cables/Leads, Electrosurgical Unit	UMDN Code 11496
8.3 Cameras, Endoscopic	UMDN Code 15748
8.4 Camera, Video, Endoscope	UMDN Code 17002

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ *นาย อธิชา โส*
(นาย อธิชา โส วิชาฮาชิ)

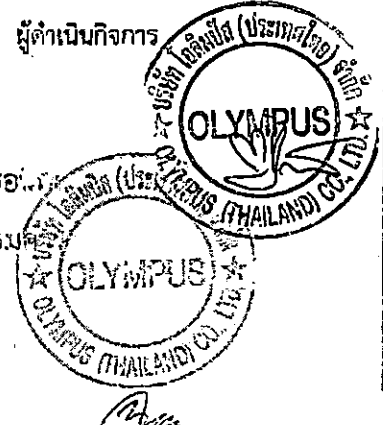

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑. ลงชื่อ..... *คุณสมใจ อภินันท์* ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... *คุณ อ. น.* กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... *คุณ อ. น.* กรรมการ

เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553


ขอขยายเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า


8.5 Caps	UMDN Code 16081
8.6 Clamps	UMDN Code 10861
8.7 Clips, Instrument	UMDN Code 10904
8.8 Clips	UMDN Code 10898
8.9 Cystoscopes, Flexible	UMDN Code 17144
8.10 Electrodes, Electrosurgical, Active	UMDN Code 16860
8.11 Electrodes, Electrosurgical, Active, Foot-Controlled	UMDN Code 16206
8.12 Electrosurgical Unit	UMDN Code 11490
8.13 Endoscope/Camera Adapters	UMDN Code 18104
8.14 Endoscope Sheaths	UMDN Code 18424
8.15 Forceps, Biopsy	UMDN Code 11775
8.16 Forceps, Dressing	UMDN Code 11777
8.17 Forceps, Laparoscopic	UMDN Code 11779
8.18 Forceps, Electrosurgical	UMDN Code 11502
8.19 Papillotomes	UMDN Code 15625
8.20 Hooks	UMDN Code 12028
8.21 Knife Handles	UMDN Code 12235
8.22 Knife Holders	UMDN Code 12236
8.23 Knife Needles	UMDN Code 12237
8.24 Laparoscopes	UMDN Code 12291
8.25 Needle Holders	UMDN Code 12726
8.26 Probes, Fistula	UMDN Code 13121
8.27 Wire, Lesion Localization	UMDN Code 17906

ขอรับรองว่าเป็นความจริง


ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการ
(นายธิดาโอะ โคบายาชิ)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ  กรรมการ

๓. ลงชื่อ  กรรมการ

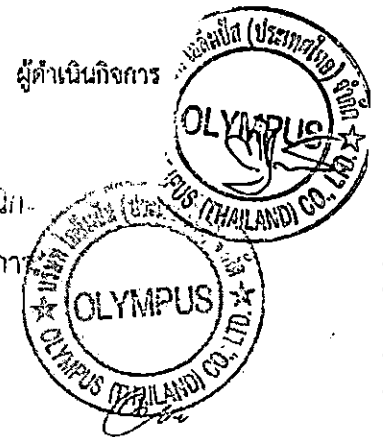

เอกสารแนบท้าย ใบจดทะเบียนที่ สน. 88/2553

ขอขยายเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า

8.28 Water-Jet Surgical Units	UMDN Code 20369
8.29 Water-Jet Surgical Units, Arthroscopic	UMDN Code 20370
8.30 Ultrasound Surgical Units	UMDN Code 18049
8.31 Tubing, Suction	UMDN Code 16779
8.32 Monitors, Video	UMDN Code 16603
8.33 String	UMDN Code 17585
8.34 Scissors	UMDN Code 13480
8.35 Snare	UMDN Code 13630
8.36 Surgical Instrument Container Systems	UMDN Code 16349
8.37 Television Systems, Endoscope	UMDN Code 15967

9. Urology

9.1 Cystoscopes	UMDN Code 11112
9.2 Forceps, Stone Manipulation	UMDN Code 11793




ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป


ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการ
(นายวิชาโอะ โคมายาชิ)



คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ  กรรมการ
๓. ลงชื่อ  กรรมการ

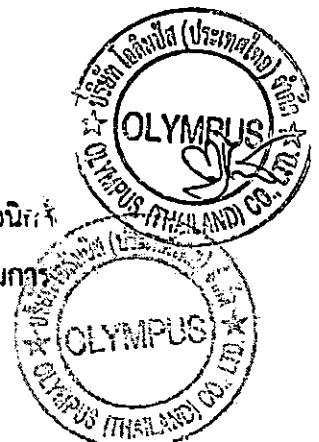



รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

อนุญาตให้เพิ่มขอบข่ายและรายการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่

1. Materials Management

- 1.1 Adapter Cables, Pressure Transducer UMDN Code 16969
- 1.2 Cleaners UMDN Code 15013
- 1.3 Sterilization Containers UMDN Code 13730
- 1.4 Ultrasound Cleaning Systems UMDN Code 14263
- 1.5 Video Image Processors UMDN Code 18037

2. Clinical Laboratory

- 2.1 Analyzers UMDN Code 18611
- 2.2 Mouthpieces, Pipette Safety UMDN Code 17824

3. Pathology

- 3.1. Brushes, Cytology UMDN Code 15018

4. Health Facility

- 4.1 Valves UMDN Code 14325
- 4.2 Controllers UMDN Code 11009
- 4.3 Cleaners, Syringe UMDN Code 13924

5. Nursing Services

- 5.1 Aspirators UMDN Code 10208
- 5.2 Cannulae UMDN Code 10561
- 5.3 Carts, Instrument UMDN Code 10641
- 5.4 Catheters UMDN Code 10685
- 5.5 Feeding Tube Patency Restorers, Flushing UMDN Code 18593
- 5.6 Irrigation Kits UMDN Code 15585
- 5.7 Tubes UMDN Code 14175
- 5.8 Trocars UMDN Code 14154
- 5.9 Trays UMDN Code 15609
- 5.10 Stopcocks UMDN Code 13803
- 5.11 Syringe, Plunger, Cather, Catheter Tip, Aspiration/Irrigation UMDN Code 20270
- 5.12 Syringe/Needle Adapters UMDN Code 13922



ผู้ซึ่งเลขอ้างอิงคณะกรรมการอาหารและยาของหมวด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ..... *ศิริกานต์ จกักรุณ*ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ..... *น.ส.กัญญา*กรรมการ

๓.ลงชื่อ..... *อนันต์*กรรมการ



6. Cardiology

6.1 Guide Wires

UMDN Code 11925

6.2 Suction Tips, General-purpose

UMDN Code 16883

7. Radiology

7.1. Transducers, Ultrasonic

UMDN Code 14121


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

- 3 ต.ค. 2562

เป็นต้นไป



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อเครื่องรอกซ์
 ๑. ลงชื่อ..... *ศิริมาลี จิตวิญญู* ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... *ปิยะ งาม* กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... *อนันต์* กรรมการ



(Signature)

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับจดทะเบียนสถานประกอบการ ดังนี้


1. เปลี่ยนแปลงแผนผังสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 114/7 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวศรี จังหวัดเชียงใหม่ 50000 บริเวณพื้นที่ 2

2. เพิ่มห้องเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ในสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ แห่งที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 บริเวณพื้นที่ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

3 11/11-2563

เป็นต้นไป

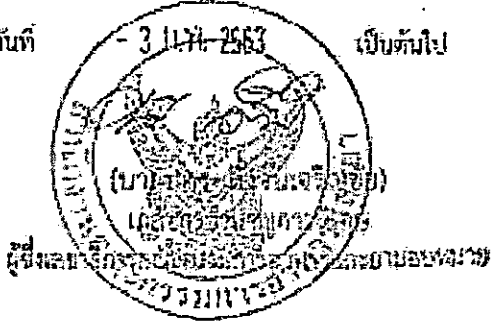

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563



อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการคน นายธิดาโอะ โสภณศรี เป็น นายเจตธี งามานโมละ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

3 11/11-2563

เป็นต้นไป




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... *ศิริมาลี งามานโมละ* ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... *ม. งามานโมละ* กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... *ม. งามานโมละ* กรรมการ

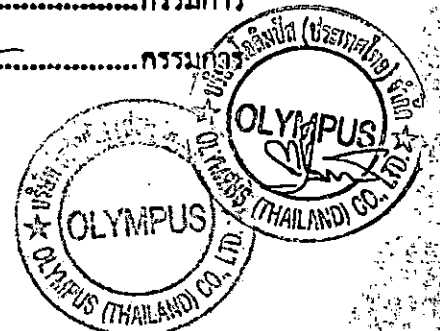

ม. งามานโมละ



รับรองทั้งหมด
หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเลขที่ JPN 6306071

23 มิถุนายน 2563

ได้พิจารณาหนังสือรับรองการขาย/หนังสือรับรองการขายและหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตแล้ว
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : AIZU OLYMPUS CO.,LTD.

หนังสือฉบับนี้ใช้ประกอบกับ หนังสือรับรองการขายเลขที่ 5936
ประเทศ Japan
 หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตเลขที่ 81 105 5776
สามารถใช้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2568



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อนุญาต

เงื่อนไข

- เมื่อปรากฏว่าประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ห้ามขาย หรือมีการยกเลิกการรับรองระบบคุณภาพการผลิตของเครื่องมือแพทย์รายการใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ถือว่ามีการรับรองเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
- ห้ามนำเลขที่หนังสือไปประกาศโฆษณา
- ห้ามโฆษณาว่าได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ห้ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก/เพิกถอนหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้ หากผู้นำเข้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว

หมายเหตุเพิ่มเติม

ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการบันทึกเข้ามาทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ
- ลงชื่อ.....กรรมการ



(Signature)

เอกสารแนบท้ายหนังสือเลขที่ JPN 6306071

เลขที่หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต

ชื่อผู้ผลิต AIZU OLYMPUS CO.,LTD.

ประเทศ Japan

ISO เลขที่ 81 105 5776




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... วิวัฒน์ วัฒนวิทย์ ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... ประจักษ์ กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... อนันต์ กรรมการ



อนันต์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 รายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ JPN 6306071
 วันที่อนุมัติ 23/6/2563 วันที่หมดอายุ 10/3/2568

1. หน่วยงานขายของรหัส Owner
 ชื่อ รหัส 3969 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.

ประเทศ Japan



2. หน่วยงานขายของรหัส manuccd
 ชื่อ รหัส 3970 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ AIZU OLYMPUS CO.,LTD.

ประเทศ Japan

manuccd	gmpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefitemNo
3970	81 105 5776	TJF-Q190V	EVIS EXERA III DUODENOVideoscope OLYMPUS		DUODENOVideoscope OLYMPUS TJF-Q190V	1	11359		6303970000026
3969	81 105 5776	MA-392	MOUTHPIECE		MOUTHPIECE MA-392	1	17824		6303970000027
3969	81 105 5776	MB-156	ETO CAP		ETO CAP MB-156	1	16349		6303970000028
3969	81 105 5776	MH-944	CHANNEL PLUG		CHANNEL PLUG MH-944	1	16349		6303970000029
3969	81 105 5776	MH-946	INJECTION TUBE		INJECTION TUBE MH-946	1	14175		6303970000030
3969	81 105 5776	BW-20T	CHANNEL CLEANING BRUSH		CHANNEL CLEANING BRUSH BW-20T	1	15018		6303970000031
3969	81 105 5776	MH-507	CHANNEL-OPENING CLEANING BRUSH		CHANNEL-OPENING CLEANING BRUSH MH-507	1	15018		6303970000032
3969	81 105 5776	MH-856	SUCTION CLEANING ADAPTER		SUCTION CLEANING ADAPTER MH-856	1	16969		6303970000033
3969	81 105 5776	MH-948	AW CHANNEL CLEANING ADAPTER		AW CHANNEL CLEANING ADAPTER MH-948	1	16969		6303970000034
3969	81 105 5776	BW-412T	Single Use Combination Cleaning Brush		Single Use Combination Cleaning Brush BW-412T	1	15018		6303970000035
3969	81 105 5776	MAJ-2319	Distal-end flushing adapter		Distal-end flushing adapter MAJ-2319	1	16969		6303970000036

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ



**MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE
GOVERNMENT OF JAPAN**
2-2, KASUMIGASEKI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8916

CERTIFICATE

It is hereby certified that the following medical device marketed by OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP., 2-43-2 Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072 Japan is manufactured under our supervision as stipulated in the Pharmaceuticals, Medical devices and Other Therapeutic Products Act of Japan, and is certified by Certification Body to be marketed in Japan.

Medical device:

EVIS EXERA III DUODENOVideoscope OLYMPUS TJF-Q190V No. 5148 / 2563

Components:

- MOUTHPIECE MA-392
- ETO CAP MB-156
- CHANNEL PLUG MH-944
- INJECTION TUBE MH-946
- CHANNEL CLEANING BRUSH BW-20T
- CHANNEL-OPENING CLEANING BRUSH MH-507
- SUCTION CLEANING ADAPTER MH-856
- AW CHANNEL CLEANING ADAPTER MH-948
- Single Use Combination Cleaning Brush BW-412T
- Distal-end flushing adapter MAJ-2319



Name of Registered Certification Body: TÜV Rheinland Japan Ltd.

Certification Number : 301ABBZX00014000

Date of Issue : May 24, 2019

Manufacturing Site and Address : Aizu Olympus Co., Ltd.
500 Muranishi, Niidera, Monden-machi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima
965-8520, Japan



No 5936

Tokyo, date MAR. 11. 2020

For legalization by the foreign consul in Japan, this is to certify that the Seal affixed to this document is genuine.

Tokyo, JUN. 1 2020 *tanaka toshie*
Official
Ministry of Foreign Affairs
(Consular Service Division)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.ลงชื่อ.....*ศิริกมล จงษ์ พุฒ*.....ประธานกรรมการ
๒.ลงชื่อ.....*รัฐ*.....

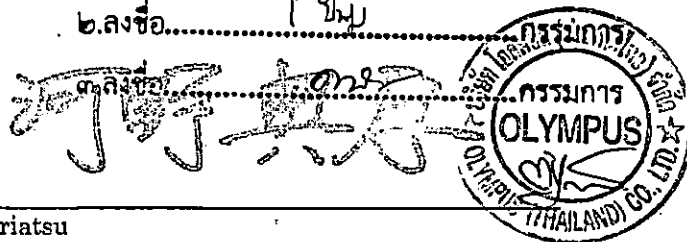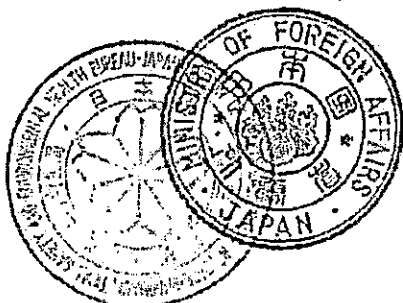

KONO Noriatsu
Director, Medical Device Evaluation Division
Pharmaceutical Safety and Environmental Health Bureau
Ministry of Health, Labour and Welfare.





รับรองบางส่วน
หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเลขที่ JPN 6307859

21 สิงหาคม 2563

ได้พิจารณาหนังสือรับรองการขาย/หนังสือรับรองการขายและหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตแล้ว
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : SHIRAKAWA OLYMPUS CO., LTD.

หนังสือฉบับนี้ใช้ประกอบกับ หนังสือรับรองการขายเลขที่ 1293
ประเทศ Japan
 หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตเลขที่
สามารถใช้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2568



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อนุญาต


เงื่อนไข

- 1. เมื่อปรากฏว่าประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ห้ามขาย หรือมีการยกเลิกการรับรองระบบคุณภาพการผลิต
ของเครื่องมือแพทย์รายการใดตามทีระบุไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ถือว่าการรับรองเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
- 2. ห้ามนำเลขที่หนังสือไปประกาศโฆษณา
- 3. ห้ามโฆษณาว่าได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 4. ห้ามโฆษณาเครื่องมือแพทย์ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก/เพิกถอนหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ฉบับนี้
หากผู้นำเข้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว

หมายเหตุเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ผู้ประกอบการบันทึกเข้ามาทั้งหมดถือเป็นความลับของผู้ประกอบการ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ



Handwritten signature

เอกสารแนบท้ายหนังสือเลขที่ JPN 6307859

เลขที่หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต

ชื่อผู้ผลิต SHIRAKAWA OLYMPUS CO., LTD.

ประเทศ Japan


ISO เลขที่

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... *ศิริพงษ์ จงษ์ขจร* ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... *ธีร* กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... *อน* กรรมการ



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 รายงานนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ JPN 6307859
 วันที่อนุมัติ 21/8/2563 วันที่หมดอายุ 29/6/2568

ความหมายของรหัส Owner

1 รหัส 3969 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.

ความหมายของรหัส manucd

1 รหัส 3973 ชื่อเจ้าของ/ผู้ผลิตต่างประเทศ SHIRAKAWA OLYMPUS CO., LTD.

ประเทศ Japan

ประเทศ Japan

Owner	manucd	grpno	catno	offname	pdtname	desc	pageno	umdn	gmdn	RefitemNo
3969	3973		CV-1500	EVIS X1 VIDEO SYSTEM CENTER OLYMPUS		EVIS X1 VIDEO SYSTEM CENTER OLYMPUS CV-1500	1	18037		6303973329659
3969	3973		MAJ-901	WATER CONTAINER		WATER CONTAINER MAJ- 901	1	16349		6303973329660
3969	3973		MAJ-2431	Foot Holder		Foot Holder MAJ-2431	1	16349		6303973329661
3969	3973		MAJ-2428	12G-SDI cable 2.9M		12G-SDI cable 2.9M MAJ- 2428	1	16349		6303973329662
3969	3973		MAJ-2427	PORTABLE MEMORY 2		PORTABLE MEMORY 2 MAJ-2427	1	16349		6303973329663
3969	3973		MAJ-941	WHITE CAP SET		WHITE CAP SET MAJ-941	1	16349		6303973329664

ขอแจ้งกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 27/7/2563
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ



Signature

MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE
GOVERNMENT OF JAPAN
2-2, KASUMIGASEKI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8916

CERTIFICATE

It is hereby certified that the following medical device marketed by OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP., 2-43-2 Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072 Japan is manufactured under our supervision as stipulated in the Pharmaceuticals, Medical devices and Other Therapeutic Products Act of Japan, and is certified by Certification Body to be marketed in Japan.

Medical device:

EVIS X1 VIDEO SYSTEM CENTER OLYMPUS CV-1500

Components:

WATER CONTAINER MAJ-901

Foot Holder MAJ-2431

12G-SDI cable 2.9M MAJ-2428

PORTABLE MEMORY 2 MAJ-2427

WHITE CAP SET MAJ-941

Cable color sheet

POWER CORD US MAJ-2270

POWER CORD TW MAJ-2271

POWER CORD IN MAJ-2272

POWER CORD EU MAJ-2273

POWER CORD KR MAJ-2274

POWER CORD RU MAJ-2275

POWER CORD GB MAJ-2276

POWER CORD IL MAJ-2277

POWER CORD AR MAJ-2278

POWER CORD AU MAJ-2279

POWER CORD CN MAJ-2280

POWER CORD CH MAJ-2281

POWER CORD DK MAJ-2282

POWER CORD IT MAJ-2283

POWER CORD ZA MAJ-2284

POWER CORD BR MAJ-2285


POWER CORD TH MAJ-2286

POWER CORD PH MAJ-2364

POWER CORD MX MAJ-2365

No. 6792/2563

Tokyo 20 JUL 2020

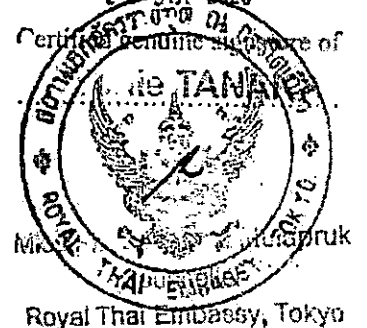

Name of Registered Certification Body: TÜV Rheinland Japan Ltd.

For legalization by the foreign consul in Japan, this is to certify that the Seal affixed to this document is genuine.

Certification Number 302ABBZX00017000

Tokyo, JUL 21 2020

tanaka toshie

Date of Issue: April 17, 2020

Official
Ministry of Foreign Affairs
(Consular Service Division)

Manufacturing Site and Address: Shirakawa Olympus Co., Ltd.
3-1 Okamiyama, Odakura, Nishigo-mura Nishishirakawa-gun, Fukushima 961-8061, Japan

No 1293


Tokyo, date JUN. 30. 2020

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

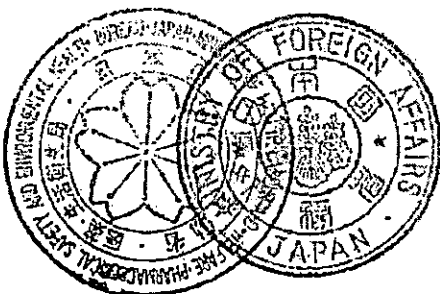


KONO Noriatsu
Director, Medical Device Evaluation Division
Pharmaceutical Safety and Environmental Health Bureau
Ministry of Health, Labour and Welfare

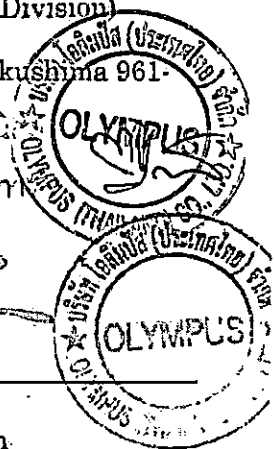

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

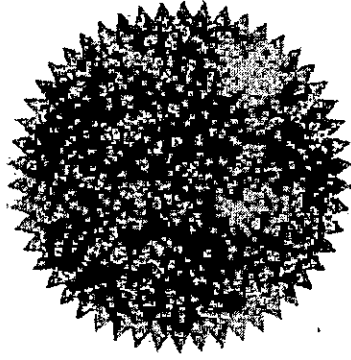

It is hereby certified that

Mr. Viit Chansiri

OF

Olympus (THAILAND) Co., LTD.

Has successfully completed the

Field Service Training

for Installation, CDS, Inspection and Troubleshooting

From 18th April to 22nd April 2011



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจอเล็ก

๑. ลงชื่อ..... *วิฑิต ชันศิริ* ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... *วิฑิต ชันศิริ* กรรมการ


๓. ลงชื่อ..... *วิฑิต ชันศิริ* กรรมการ

วิฑิต ชันศิริ
Koicat Fijita

Head of Medical Service Business Unit

Medical Business Division

Olympus Corporation of Asia Pacific Limited



บัญชีเงินฝากเงินออมทรัพย์ - บัญชีเงินฝากเงินออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา



1. บัญชีเงินฝากใหม่ในทุกครั้งที่มีการปิดบัญชีธนาคาร
2. การเปลี่ยนสมุดฝากเงินหรือการถอนเงินต่างสาขาทุกครั้ง ต้องแสดงเอกสารแสดงตน เช่นฉพาะในทางราชการ กรณีผู้มีอายุต่ำกว่าสิบเจ็ดปีต้องพำนักในเขตพำนักเงินออมทรัพย์
3. ถ้าสมุดฝากใหม่มีขาด หรือสูญหาย กรุณาแจ้งฝ่ายบัญชี หรือที่ติดต่อ โทร. 02-2261-8119
4. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดฝากเงินเท่านั้น ซึ่งถือใบได้ว่าจะออกหนังสือใบสมุดเงินฝากเงินออมทรัพย์ฉบับจริง
5. ใบกรณียกบัญชีธนาคารออมทรัพย์จะต้องออกหนังสือแจ้งว่าได้รับการกำหนด ผู้ฝากเงินยอมให้ธนาคารปิดบัญชี/ หรือคิดค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนด
6. กรณีมีการถอนเงินจากผู้ฝากเงินรับบัญชีได้ตามกฎหมาย ละเมิด บัญชีเงินฝากเงินออมทรัพย์บัญชีเงินฝากเงินออมทรัพย์

CD = ฝากเงินสด
 CL = ฝากด้วยเงินออม
 CW = ถอนเงินออม

DI = เงินฝากออมทรัพย์
 ER = รายการฝากเงิน
 RT = เงินฝาก

TD = ฝากโดยการโอน
 TW = ถอนโดยการโอน/
 ถอนโดยการโอนบัญชีเงินฝากเงินออมทรัพย์

29/03/2565 10:40:00 0434A 1894500003 0020065600 0020065600 5600
 เลขหมายต้นเดิม Cell 1572

สำนักงาน Office	โทร. 0-2261-8119, 0-2261-8120	
ชื่อบัญชี Name of Account	บริษัท โอลิปบัส (ประเทศไทย) จำกัด	
บัญชีเลขที่ Account No.	109-1-17450-3	
001 บัญชีออมทรัพย์ มีสมุด		
 (งา)		เลขประจำตัว Serial No. 0020065600

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกอภิบาล
 ชื่อบัญชี บริษัท โอลิปบัส(ประเทศไทย) จำกัด (Olympus (Thailand) Co., Ltd)
 เลขที่บัญชี 109-1-17450-3 ประเภทออมทรัพย์

