

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ นฐ ๐๐๓๓/ ๑๐๖ /๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดนครปฐม โดย นายสุรชัย โชคครรชิตไชย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุธร เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๓๕๔๔๐๓๔๖๒๙ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ๑๐๓๕/๘๖ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยนายวศิน สมภาวะ ตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๑๓๒๙๒๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ , แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องปั๊มลมสกรูขนาด ๒๐ แรงม้า รุ่น OSP - ๑๕M๕AN๒(๑) ยี่ห้อ HITACHI ผลิตภัณฑประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๔๖๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน	๑	หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	๒	หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ แค็ตตาล็อก	จำนวน	๔	หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร	จำนวน	๑	หน้า

<https://process3.gprocurement.go.th/epecontractWeb/jsp/control.econtract>



ผู้ซื้อ.....	ผู้ขาย.....
พยาน.....	พยาน.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลนครปฐมภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลนครปฐมในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเตาปูน ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุธร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย เลขที่บัญชี ๐๒๐-๑-๕๑๔๕๗-๕ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ผู้ซื้อ..... ผู้ขาย.....
พยาน..... พยาน.....

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อที่มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อที่มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นเงินสดมาเป็นหลักประกันสัญญา ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๐๑๖๓ เลขที่ ๓๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๐๐๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวง ตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาผู้ซื้อที่มีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเติมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย



ผู้ซื้อ.....	ผู้ขาย.....
พยาน.....	พยาน.....

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในกรณีที่จะของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ผู้ซื้อ.....	ผู้ขาย.....
พยาน.....	พยาน.....

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา เป็นสิ่งของผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรัชย์ โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายวศิน สมภาวะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจุฑาภรณ์ สามสีทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอัญชิสา พานแก้ว)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๒๗๐๘๐๘๑๐

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๕๐๑๐๐๔๒๕๓

<https://process3.gprocurement.go.th/cgpecontractWeb/jsp/control.econtract>

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/.....๑๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จังหวัดนครปฐม ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องปั๊มลมสกรูขนาด ๒๐ แรงม้า รุ่น OSP - ๑๕M๕AN๒(๑) ยี่ห้อ HITACHI ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ เครื่อง จากห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุธร เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย ดังรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ ประกอบด้วยเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. ผนวก ๑ ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒. ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๓. ผนวก ๓ แค็ตตาล็อก | จำนวน ๔ หน้า |
| ๔. ผนวก ๔ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร | จำนวน ๑ หน้า |



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายวศิน สมภาวะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจุฑาภรณ์ สามสีทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอัญชิสรา พานแก้ว)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุธร เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย

WASUTHORN ENGINEERING & SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

1035/86 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์.(02) 444-2932 โทรสาร.(02) 444-2931

1035/86 KRUNGTEP-NONTHABURI Rd.,WONGSAWANG BANGSUE BANGKOK 10800 Tel.(02) 444-2932 Fax.(02) 444-2931

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1035 44034 62 9/TAX ID 0 1035 44034 62 9

ใบเสนอราคา
(QUOTATION)

ชื่อลูกค้า โรงพยาบาลนครปฐม เลขที่(No.) W.2023/00003
ที่อยู่: 169 ถ.เทศบาล ต.พระปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร. 034 - 254150 โทรสาร 034 - 213221 วันที่ (Date) 20/02/2566
เรื่อง: ขอเสนอราคาชุดบี้มลมแบบสกรู (SCREW COMPRESSOR) ตึกส่นับสนุน
เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
สำเนา: คุณ สุธีพงศ์ อ่อนมณี / อупกรณ์การแพทย์
ห้างฯ มีความยินดีขอเสนอราคาชุดบี้มลมสกรู (SCREW COMPRESSOR) ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit price	ราคารวม Amount
1	"HITACHI" SCREW COMPRESSOR Model: OSP-15M5AN2(L) ผลิตที่ประเทศไทย - บี้มลมสกรู ฮิตาชิ ขนาด 20 แรงม้า รุ่น:OSP-15M5AN2(1) - ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ - แรงดันการทำงาน 7,8.5 บาร์ - อัตราการผลิตลม 2,350ลิตร/นาที,ที่แรงดันลม 7 บาร์ - มอเตอร์คลาส F, 20 แรงม้า, ไฟ 380 โวลต์, 3 เฟส,50เฮิร์ต - ขนาดของท่อส่งลมออก 1 นิ้ว - ขนาด 930x770x1,250มิลลิเมตร - น้ำหนัก 350 กิโลกรัม - ระดับความดังของเสียง 61 ดบีเบล	1 Unit	430,000.00	430,000.00
2	ชุดเครื่องขจัดความชื้น AIR DRYER (JM) Model:JM-20GW Capacity:2.6 m ³ /min	1 Ea		
3	ชุดกรองอากาศอัด AIR FILTER Model:YT-002 Capacity:2.6 m ³ /min	1 Ea		
	สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน		มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	430,000.00 30,100.00 460,100.00

กำหนดส่งของ ภายใน 90 วัน

กำหนดยื่นราคา 90 วัน

รับประกัน 2 ปี

ห้างฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับพิจารณาจากท่านในเร็ววันนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ



(นายวศิน สมภาวะ)


หุ้นส่วนผู้จัดการ
Mobile: 095 -6707697

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องเป่าลมสกูร์ ขนาด ๒๐ แรงม้า

๑. เกณฑ์ทำงานกำหนดทั่วไป เครื่องผลิตอากาศอัด จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ KW พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งให้เป็นไปตามรูปแบบตามเอกสาร ให้แล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพพร้อม
๒. เครื่องผลิตอากาศอัด เครื่องผลิตอากาศอัด แบบ Screw Air Compressor จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ KW พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต แต่ละตัวมีรายละเอียดทางเทคนิคดังต่อไปนี้
 - ๒.๑ เครื่องผลิตอากาศอัดทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต สมบูรณ์แบบทั้งชุด
 - ๒.๒ เครื่องผลิตอากาศอัด (Air Compressor Pump) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นชนิดใช้น้ำมันหล่อลื่น แบบ Screw มีชุดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled) ชุดวาล์วระบายแรงดัน ชุดต่อ เข้าสายระบบไฟฟ้า ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เครื่องสามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ L/min (@ ๗ bar) รวม ๑ เครื่อง สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ MPa มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๕ KW ใช้กับระบบไฟ ๓๘๐ Volt ๓ Phase ๕๐ Hz
 - ๒.๓ วาล์วกันย้อน Shut off valve ,Flex Joint ,Safety valve, Pressure switch ,Gauge
๓. ผู้ควบคุมการทำงานของเครื่อง
 - ๓.๑ ผู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับควบคุมการทำงานของมอเตอร์การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างน้อยประกอบด้วย
 - ON – OFF SWITCH
 - PHASE PROTECTION
 - BREAKER MAIN ๒ ตัว
 - A/C MAGNETIC CONTACTOR WITH OVERLOAD
 - RELAY CONTACT, THERMAL MARK, LEAD CONTROL
 - TIMER RELAY
 - HOUR METER
 - SELECTER SWITCH เลือกการทำงานแบบอัตโนมัติ แบบควบคุมด้วยมือ และสามารถปิดการทำงานได้, PILOT LAMP, PHASE PROTECTION พร้อมด้วยตู้เหล็กอย่างหนา ตามมาตรฐานในท้องตลาด

/คุณลักษณะเฉพาะ...

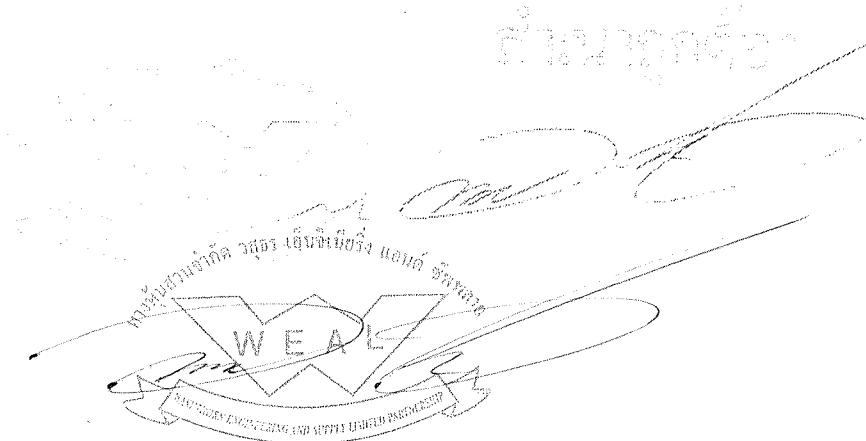


๔. คุณสมบัติเฉพาะเครื่องขจัดความชื้น (AIR DRYER)

- ๔.๑ เครื่องขจัดความชื้น (AIR DRYER) จำนวน ๑ เครื่อง
- ๔.๒ เครื่องกำจัดความชื้นเป็นแบบ Refrigerated Air Dryer R-๑๓๔
- ๔.๓ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- ๔.๔ เครื่องสามารถรับอัตราการไหลผ่านของอากาศอัดได้ไม่น้อยกว่า (Capacity) ๒.๖ m³/min @dew point ๑๐°C
- ๔.๕ เครื่องสามารถทนความดันได้สูงสุด ๐.๘๘ MPa
- ๔.๖ เครื่องมีขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓/๔ HP เป็นแบบ Single-Phase ๒๒๐ V/๕๐Hz
- ๔.๗ เครื่องรองรับ Inlet Air Temperature ๒- ๔๕ °C

๕. ชุดกรองอากาศ (AIR FILTER) อุปกรณ์กรอง FILTER ที่สามารถกักละอองน้ำมัน สามารถกรองกลิ่น สามารถดักฝุ่นละอองสามารถรับอัตราการไหลเวียนอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๒.๖ m³/min ที่ ๑๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ


๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๒ ผู้ขายยอมรับประกันการชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาเกิดการชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือผู้ขายต้องจัดหาเครื่องที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีมาสำรองใช้ระหว่างการซ่อม
- ๖.๓ ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องพร้อมอุปกรณ์ในตำแหน่งที่โรงพยาบาลกำหนดจนสามารถใช้งานได้ดี โดยค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องเป็นของผู้ขายทั้งหมดเป็นของผู้ขาย จะเรียกเก็บจากโรงพยาบาลไม่ได้
- ๖.๔ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรม หรือแนะนำวิธีการใช้งาน ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนจนกว่าจะใช้งานได้ดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

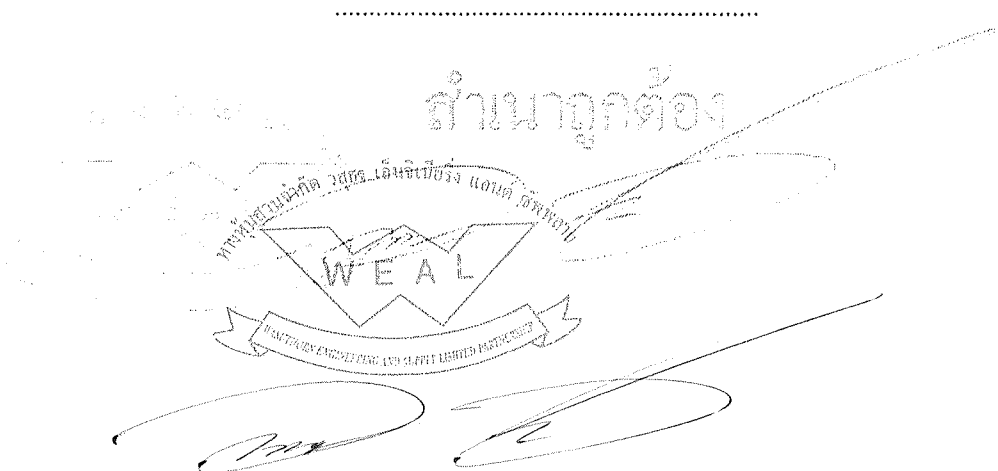

HITACHI
Inspire the Next

HISCREW
NEXT II series (11-37kW)

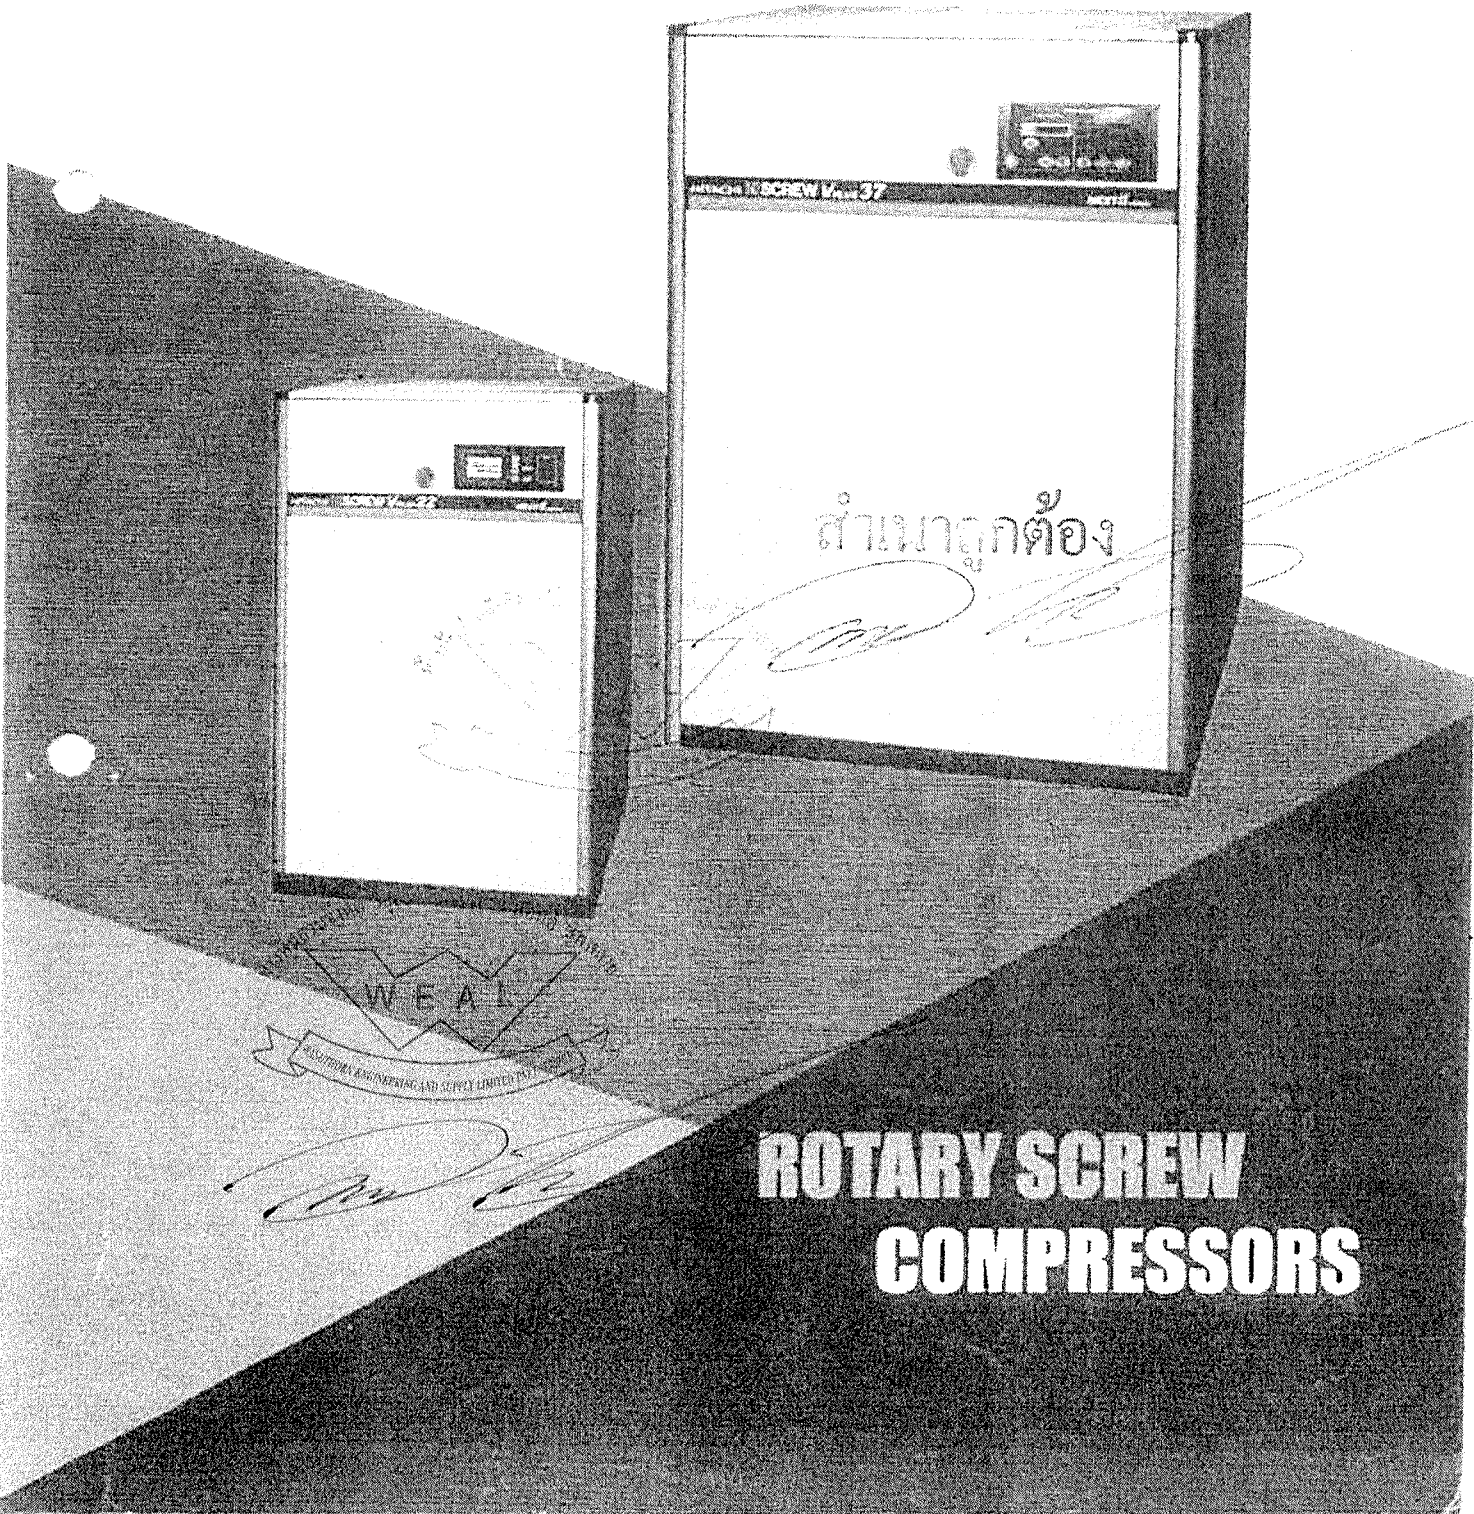


**ROTARY SCREW
COMPRESSORS**

VPLUS (VSD)


Item / Unit		Model	OSP-11VAN2-L		OSP-15VAN2-L	
Cooling Method			Air-Cooled			
Nominal Output		kW	11		15	
		HP	15		20	
Rated	Discharge Pressure	MPa	0.85			
		PSI	123			
	Discharge Capacity	m ³ /min	1.63		2.15	
		CFM	58		75	
PQ WIDE MODE	Discharge Pressure	MPa	0.7	0.9	0.7	0.9
		PSI	102	131	102	131
	Discharge Capacity	m ³ /min	1.79	1.53	2.4	2.04
		CFM	63	54	85	72
Intake Air Pressure / Temperature		-	Atmospheric Pressure / 0 to 45°C			
Discharge Temperature		°C	Atmospheric Temperature + 15 or below			
Driving Method		-	Inverter + 4-Poles TEFC Motor with V-Belt Drive			
Starting Type		-	Inverter Start			
Lubricating Oil		-	HITACHI NEW HISCREW OIL NEXT			
Lubricating Oil Quantity		L	6		7	
Nominal Output of Cooling Fan		kW	-			
Discharge Pipe Diameter		-	Rc 1			
Dimension (W x D x H)		mm	950x780x1,250			
Weight		kg	343		378	
Sound Level		dB [A]	59		61	

OSP NEXT2 SERIES SPECIFICATION

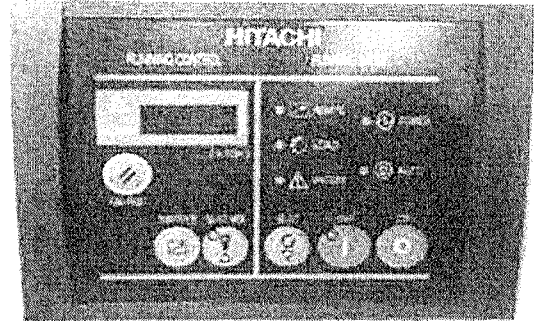

Mtype (Less Out Touch Screen Panel)


Item / Unit		Model	OSP-11M5AN2-L	OSP-15M5AN2-L	OSP-18M5AN2-L	OSP-22M5AN2-L	OSP-30M5AN2-L	OSP-37M5AN2-L
Cooling Method			Air-Cooled					
Nominal Output		kW	11	15	18	22	30	37
		HP	15	20	24	30	40	50
Rated	Discharge Pressure	MPa	0.85 <0.7>	0.85 <0.7>	0.7 <0.85>	0.7 <0.85> [1.0]	0.7 <0.85>	0.7 <0.85> [1.0]
		PSI	123 <102>	123 <102>	102 <123>	102 <123> [145]	102 <123>	102 <123> [145]
	Discharge Capacity	m ³ /min	1.63 <1.73>	2.15 <2.4>	3.4 <3.0>	4.0 <3.7> [3.3]	6.0 <5.4>	7.2 <6.6> [5.8]
		CFM	58 <63>	76 <85>	120 <106>	141 <131> [117]	212 <191>	254 <233> [205]
Intake Air Pressure / Temperature		-	Atmospheric Pressure / 0 to 45°C					
Discharge Temperature		°C	Atmospheric Temperature + 15 or below					
Driving Method		-	4-Poles TEFC Motor with V-Belt Drive					
Starting Type		-	Direct connection/Star-Delta			Star-Delta		
Lubricating Oil		-	HITACHI NEW HISCREW OIL NEXT					
Lubricating Oil Quantity		L	6	15	15	15	15	15
Nominal Output of Cooling Fan		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Discharge Pipe Diameter		-	Rc 1.1/2					
Dimension (W x D x H)		mm	950x780x1,250		1,000x1,050x1,550		1,200x1,150x1,650	
Weight		kg	338	363	670		930	
Sound Level		dB [A]	59	61	59		65	

 Hitachi Asia Ltd.


30 Pioneer Crescent #10-15, West Park Bizcentral, Singapore 628560

Tel: (65) 6305 7417 Fax: (65) 6305 7401 www.hitachi.com.sg/ice

YT/JM AIR-COOLED REFRIGERATED DRYER

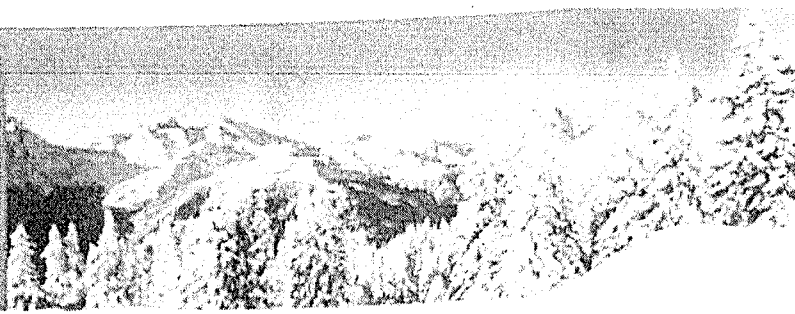

Air-cooled high-temperature refrigerated dryer adopts mature international technology, and is combined with dryer's feature of actual operation, which enable its efficient and stable working.

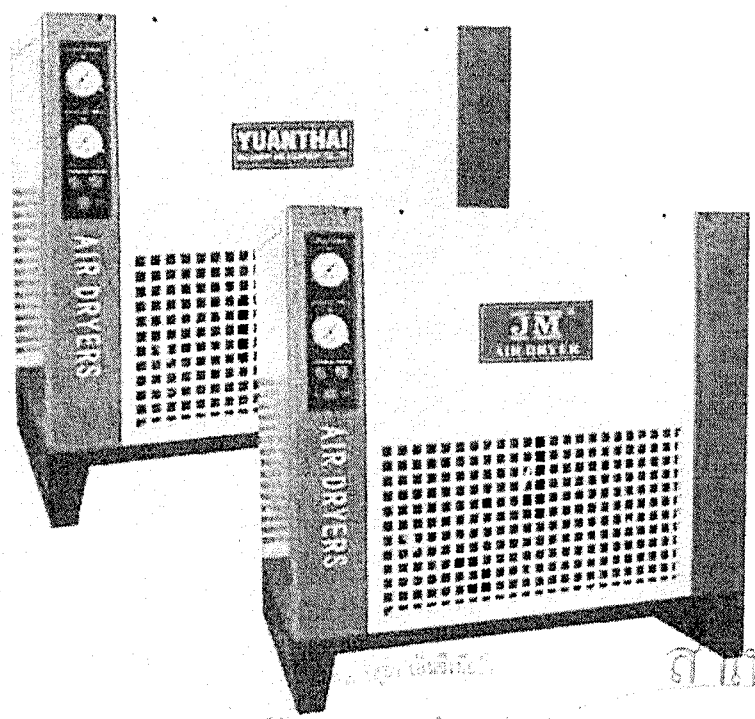


Working Condition and Technical Data

- Inlet Temperature: 2-8℃
- Ambient Temperature: 2-45℃
- Working Pressure: 0.2-1.0Mpa
- Pressure Dew Point: -1.5-10℃
- Cooling Type: Air-Cooled

- Environmental-friendly
- Sustainable and Efficient
- Long Service Life
- Low operation cost
- Wide application

Technical parameters

Model	YTJM-15GW	YTJM-15GW	YTJM-20GW	YTJM-30GW	YTJM-30GW	YTJM-50GW	YTJM-50GW	YTJM-50GW	YTJM-50GW	YTJM-50GW	
Capacity(m ³ /min)	1.5	2.0	2.6	3.6	6.5	10	13.5	20	36	36	
Conditions of Use Limit	A. Inlet Temperature:80℃ B Ambient Temperature:45℃ C Air Pressure:10kg/cm (We accept special order of super-pressure)										
Pressure Dew Point	2-5℃ (Its atmospheric dew point is equal to -20℃)										
Refrigerant	R-134/22					R-22					
Refrigerant Compressor	1/3HP	1/2HP	3/4HP	1.25HP	1.5HP	2HP	3HP	4HP	5HP	7.5HP	
Power									AC 3Φ 380V 50/60Hz		
Air In-Out (Inch)	1"	1"	1"	1.5"	1.5"	2.5"	3"	3"	4"	4"	
Dimension (mm)	Length	750	750	800	930	950	1080	1120	1230	1500	1650
	Width	420	420	420	420	420	600	700	700	200	960
	Height	730	730	730	910	1510	1040	1230	1250	1400	1300
Weight(KG)	50	53	60	90	115	135	190	200	290.5	485	

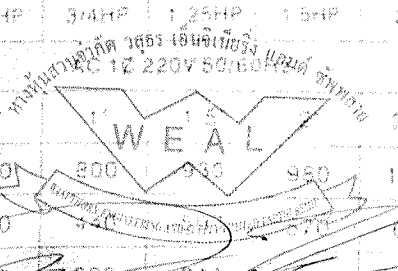



WEAL AIR COMPRESSOR

COMPRESSED AIR PRECISION FILTER

Working Condition and Technical Data


Rated working pressure:1.0

Maximum temperature of filter:80°C

Maximum temperature(Sterlization type):150°C


Features:

- High quality: Adopting the most advanced technology of Germany to produce high-polymer-material filter.
- Wide application: Filter of multiple level to remove oil, water, dust and bacteria.
- Stronger & lighter: Aluminum alloy shell, larger steel filter.

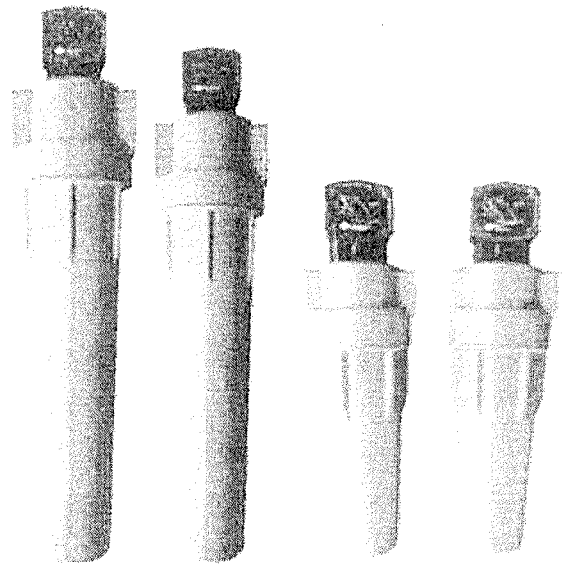

Technical Data

Model	Capacity(m ³ /min)	Working pressure(Mpa)	Pipe diameter (Inch)	Dimension (B*H)		Weight(KG)
YT-001	1.6	1.0	G1"	104	313	2
YT-002	2.6	1.0	G1"	104	313	2
YT-004	3.8	1.0	G1 1/2"	138	424	3.6
YT-007	6.8	1.0	G1 1/2"	138	630	4.9
YT-010	11	1.0	G2"	138	630	5.6
YT-013	13.6	1.0	G2"	138	630	5.6
YT-015	17	1.0	G2.5"	150	710	10.5

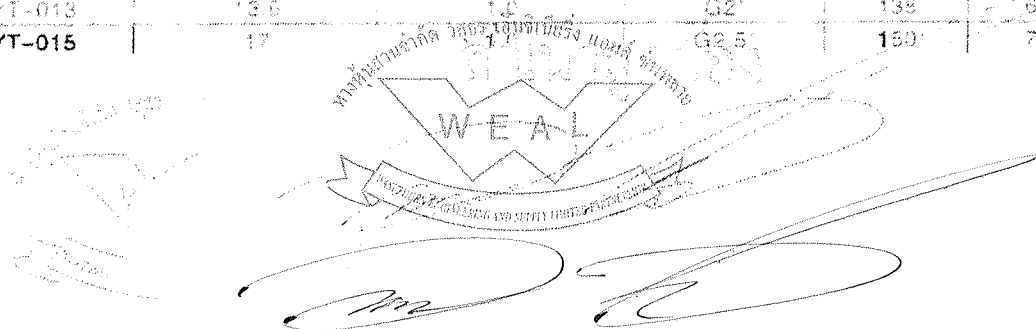

สาขาเตาปูน

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีที่ 02585-1312 02585-2198
ขอกำหนดและเงื่อนไข 7240799

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่เกิดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเพิ่มเติมให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมความเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคารควรมานำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 20
Office

บัญชีเลขที่ 020-1-51457-5
Account No.


สาขาเตาปูน

ชื่อบัญชี
Account Name

หญิง วสุธร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ วิศวกรรม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 5357225



Handwritten signatures at the bottom of the page.

เล่มที่ 0163



ใบเสร็จรับเงิน



เลขที่ 36

ในราชการ โรงพยาบาลนครปฐม

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๖

ได้รับเงินจาก ข้าวเหนียวดำก้ออสุระ เอ็มจีเนเจอร์ 1040 บาท
ตามรายละเอียดดังนี้

๕.๖.๖๖๔

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าประกันสุขภาพตั้งชื่อเครื่องแม่พิมพ์คอมพิวเตอร์ - แอมป์รับ OSP-15MBK (4) ชิ้น HIJACHI ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นขนาด 1 เครื่อง	23005 -
รวมบาท	23005 -

จำนวนเงิน - สองหมื่นสามพันห้าบาทถ้วน
(ตัวอักษร)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ธ.ค. 65)

เล่มที่ นฐ. 0001-1000

ลงชื่อ อลง

ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

