

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/.....๑๕๑...../๒๕๖๖ ลงวันที่..... ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จังหวัดนครปฐม ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้งขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร รุ่น Clenex-๑๒ ยี่ห้อ Clenex ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย จำนวน ๑ เครื่อง จากบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ ประกอบด้วยเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------|
| ๑. ผนวก ๑ ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒. ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน ๓ หน้า |
| ๓. ผนวก ๓ แค็ตตาล็อก | จำนวน ๑๘ หน้า |
| ๔. ผนวก ๔ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร | จำนวน ๑ หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

nam
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวชัชชญา สุขสถาพรชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจุฑาภรณ์ สามสีทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัญชิสา พานแก้ว)

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน)

๑. ข้าพเจ้า บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๙๙๙/๓-๕ หมู่ที่ ๙ ถนน ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๙๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๔๔๖๓๙๖ โดย นางสาวชัชชยา สุขสถาพรชัย ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้งขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร	-	-	๑ เครื่อง	๑,๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑,๖๓๕,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนออื่น เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบ **ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding** กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕

ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกออกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ จังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก

แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา
ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด
ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ -
เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล
หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด
ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๖

(นางสาวชัชชยา
สุขสถาพรชัย)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ใบเสนอราคาเลขที่ 6602160017979
รหัสอ้างอิง OTP hoZc
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๖๕๐๐๐๖๕๔

ชัชชยา สุขสถาพรชัย
nam^o
NAMWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ลงชื่อ.....*Von*.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....*ฉัตร*.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....*อน*.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุ 1,200 ลิตร
 ยี่ห้อ Clenex รุ่น Clenex-12 ผลิตภัณฑประเทศไทย

1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 เป็นเครื่องล้างท่อสายยางขนาดต่างๆ มีระบบน้ำเย็น, น้ำร้อนและมีระบบอบแห้งเครื่องมือในตัว ทำงานโดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการทำงาน ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่มีขนาดท่อเล็กและยาวทางการแพทย์ เช่น สายยางประเภทต่างๆ
 - 1.2 ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลสสตีลเป็นตู้ตั้งพื้นขนาดความจุของห้องล้าง 1200 ลิตร และมีประตูเปิด-ปิดใช้งาน 1 ประตู
 - 1.3 มีระบบทำน้ำร้อนภายในตัวเครื่อง เพื่อใช้ในขั้นตอนการล้าง
 - 1.4 ควบคุมโปรแกรมการทำงานของเครื่องด้วยระบบ Microprocessor แบบอัตโนมัติ และสั่งงานผ่านหน้าจอสัมผัส (Touch screen)
 - 1.5 ใช้ไฟฟ้า 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 3 เฟส 4 สาย
2. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - 2.1 ภายในห้องล้างมีขนาดความจุของห้องล้าง 1200 ลิตร ทำด้วยสแตนเลสสตีลเกรด 316L และส่วนประกอบฝาปิดตัวเครื่องด้านนอกทำด้วยสแตนเลสสตีล เกรด 304
 - 2.2 ภายในห้องล้าง (Washer Chamber) มีหัวฉีดสำหรับฉีดชำระล้างโดยอยู่ส่วนบนและมีระบบล้างพ่นแบบหัวฉีด (Jet Spray) อยู่บริเวณส่วนด้านข้างของห้องล้างมีระบบหัวฉีดทำความสะอาดแบบท่อพ่นผสมแรงดัน
 - 2.3 สามารถเลือกโปรแกรมการล้างและทำสายเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม เพื่อความเหมาะสมในแต่ละโปรแกรม จะมีการล้างด้วยน้ำเย็นและน้ำร้อน
 - 2.4 สามารถล้างด้วยน้ำยาล้างซึ่งจะผสมกับน้ำล้าง ซึ่งจะผสมในขณะที่ทำสายเชื้อโดยควบคุมการใช้งานของน้ำยาด้วยปั๊มที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว
 - 2.5 ตัวเครื่องมีระบบหัวฉีดเพื่อรองรับสายท่อที่ใช้ล้างไม่น้อยกว่า 3 ขนาด และสามารถล้างท่อต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 100 เส้น ต่อรอบ
 - 2.6 มีปั๊มน้ำหมุนเวียน (Circulation Pump) จำนวน 1 ปั๊ม
 - 2.7 มีปั๊มน้ำระบายน้ำทิ้ง (Vertical Drain Pump) จำนวน 1 ปั๊ม
 - 2.8 มีปั๊มดูดน้ำยาเคมีที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปั๊ม และมีถังบรรจุน้ำยาสำหรับใช้ในการชำระล้างถูกติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ถัง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อ.....

- 2.9 มีระบบอบแห้งอุปรกรณ์ (Hot Air Drying System) ภายหลังจากเสร็จสิ้นการล้างฆ่าเชื้ออุปรกรณ์ในเครื่องเดียวกันภายในการทำงานเพียงครั้งเดียว
- 2.10 มีระบบตรวจสอบอุณหภูมิในห้องล้าง (Double Temperature Checked) เพื่อป้องกันการผิดพลาดของอุณหภูมิ
- 2.11 ผู้ใช้สามารถเลือกโปรแกรมการล้างที่แตกต่างกันไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม และสามารถตั้งโปรแกรมทำงานเองได้ โดยเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติจนจบขั้นตอนในโปรแกรมนั้นๆ

3. ระบบควบคุมการทำงาน

- 3.1 ตัวเครื่องถูกควบคุมด้วยระบบ Microprocessor
- 3.2 มีระบบ Software ที่สามารถอ่านโปรแกรม และอ่านค่าต่างๆที่สำคัญได้จากหน้าจอเครื่องโดยหน้าจอภาพสามารถแสดงสถานะต่างๆขณะที่เครื่องทำงานให้ทราบดังนี้
 - 3.2.1 โปรแกรมการทำงานในแต่ละช่วง
 - 3.2.2 โปรแกรมที่เลือก
 - 3.2.3 อุณหภูมิของน้ำในห้องล้าง
 - 3.2.4 เวลาการทำงาน
 - 3.2.5 ความผิดปกติของระบบ
- 3.3 ในขณะที่เครื่องทำการล้างและฆ่าเชื้อหากมีข้อผิดพลาดหรือขัดข้อง เครื่องจะหยุดทำงานและมีเสียงสัญญาณเตือนและควบคุมการทำงานของเครื่องจะแสดง Fault Code บอกสาเหตุที่เครื่องทำงานผิดปกติบน Display

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....*V. m...*.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....*พิเชษฐ ใจใส่ม...*.....กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ.....*อน...*.....กรรมการ

4. อุปกรณ์ประกอบ


- 4.1 เครื่องกรองน้ำแบบอัตโนมัติ (RO)
 - 4.2 น้ำยาสำหรับการล้างฆ่าเชื้ออุปรกรณ์และเครื่องมือ
 - 4.3 เครื่องบีบลม Air compressor ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
 - 4.4 ถังพักน้ำสแตนเลสขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร
- จำนวน 30 ลิตร
 จำนวน 1 เครื่อง
 จำนวน 1 ใบ

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 , ISO 13485:2016, ISO 14001:2015
- 5.2 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE
- 5.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

จิรุต ใจใส่ม...

- 5.4 รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี ผู้ขายจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญมาตรวจสอบบำรุงรักษา อย่างน้อย 3 เดือน/ปี ผู้ขายจะต้องสาธิตแนะนำการใช้เครื่องและสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใช้ เครื่องและอบรมบำรุงรักษาเครื่องให้แก่ช่างโรงพยาบาล
- 5.5 มีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และมีใบรับรองการผ่านงานดูแลรักษาเครื่องจาก บริษัทผู้ผลิต
- 5.6 มีคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย 1 ชุด




ชัชวาล สุพัฒน์พงษ์



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.ลงชื่อ..... *Vms* ประธานกรรมการ
- ๒.ลงชื่อ..... *พิศม* กรรมการ
- ๓.ลงชื่อ..... *ณ* กรรมการ

ชัชวาล สุพัฒน์พงษ์

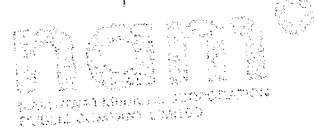

เลขที่ SO 2566/743

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

เรื่อง หนังสือรับประกันสินค้า

เรียน คณะกรรมการเปิดซอง

ตามที่ทางบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารประมูลราคากับทางโรงพยาบาลนครปฐม รายการเครื่องล้าง
สายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง บริษัทฯขอยืนยัน
การรับประกันคุณภาพสินค้า รวมถึงอะไหล่ทุกชิ้นส่วน จากเดิมระยะเวลาประกัน 1 ปี ขยายเวลา
รับประกันเพิ่มให้เป็น 3 ปี ตามเงื่อนไข เพื่อเป็นผลประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงาน
นับจากวันที่ตรวจรับครุภัณฑ์เสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

nam^o
NAMWIVAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

รับทราบ
ณัฐพร
nam^o
NAMWIVAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

nam^o

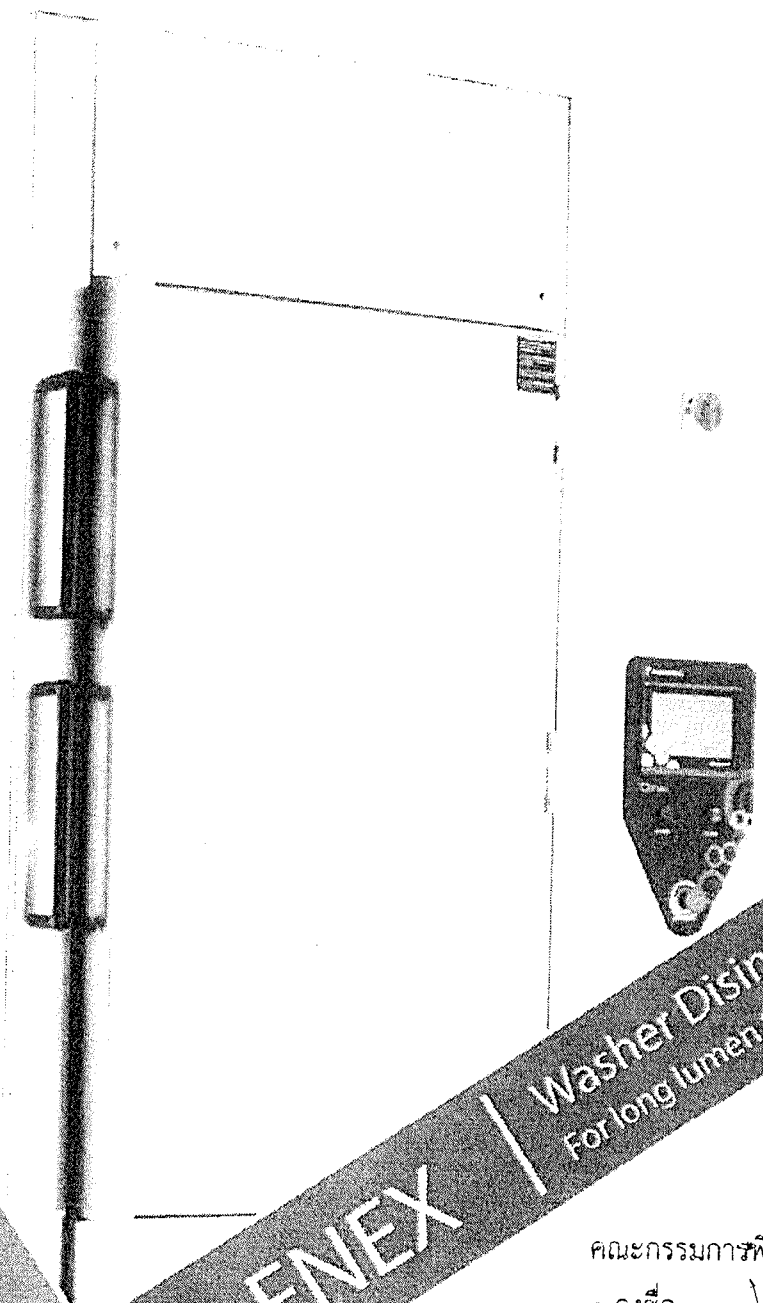

CLENEX | Washer Disinfector
For long lumen tubes


บริษัท นามวิวัฒน์
nam^o
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.ลงชื่อ.....*V. V. V.*.....ประธานกรรมการ
๒.ลงชื่อ.....*วิมล นามวิวัฒน์*.....กรรมการ
๓.ลงชื่อ.....*อนันต์*.....กรรมการ


ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่าย
nam^o
NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

PRODUCT BENEFIT


323

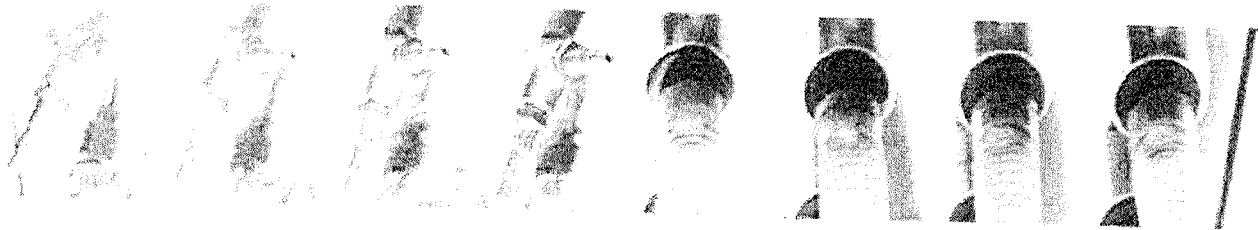


PRODUCT OPTION




Automatic Dosing Chemical Solution




Stainless Screen Plate



PLC Touch Screen



Emergency Button



Pressure Gauge

TECHNICAL DATA

2112

13

14

13

15

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อ.....

 บริษัท นามวัฒน์ จำกัด
 NAMWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

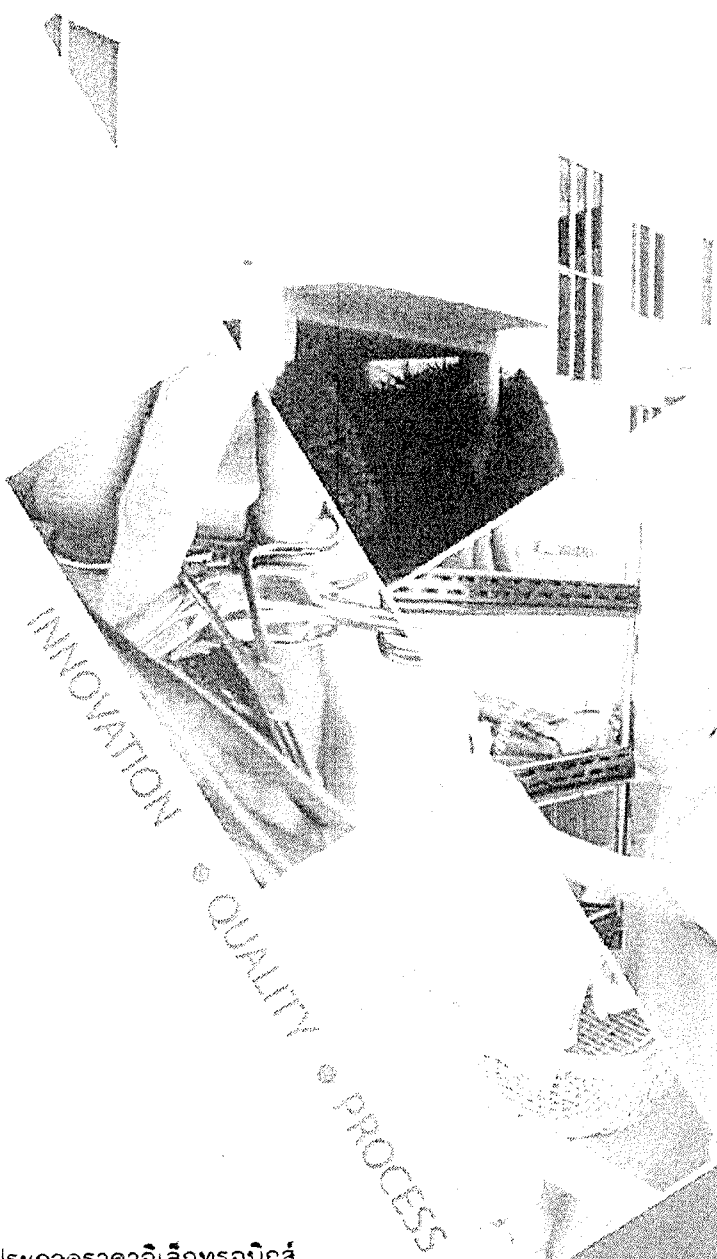

INNOVATION • QUALITY • PROCESS

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ..... *Vms*ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ..... *วิมล ภิรมย์*กรรมการ


๓.ลงชื่อ..... *อน*กรรมการ




nam NAMWIWAT CORPORATION


๑ ๑๑๑/๑-๑ บ.๑ ก.ประชาอุทิศ-คูสร้าง ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 102๑0
☎ +66 2461 72๑7-90 ☎ +66 2461 72๑1

วิมล ภิรมย์



วิมล ภิรมย์

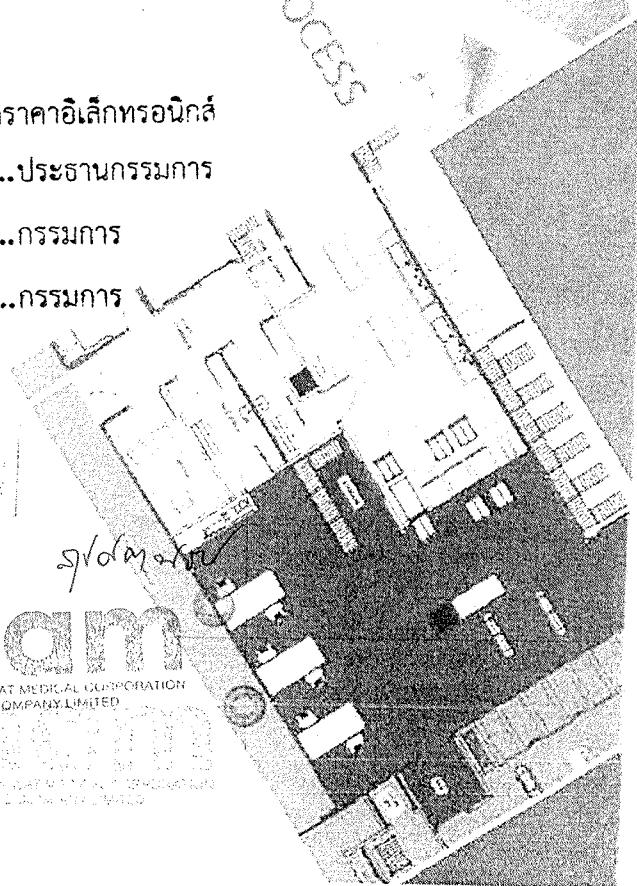




คุณสมบัติทางเทคนิค
(Technical specification)

เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง

ยี่ห้อ Clenex รุ่น Clenex-12

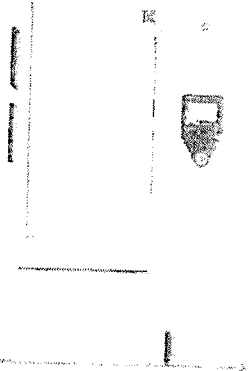

- 1. เป็นเครื่องล้างท่อสายยางขนาดต่างๆ มีระบบน้ำเย็น, น้ำร้อนและมีระบบอบแห้งเครื่องมือในตัวทำงานโดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการทำงาน ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่มีขนาดท่อเล็กและยาวทางการแพทย์ เช่น สายยางประเภทต่างๆ
- 2. เครื่องควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor หน้าจอเป็นแบบ Touch Screen สามารถแสดงค่าต่างๆ ขณะที่เครื่องทำงานได้ ดังนี้
 - 3.2.1 - โปรแกรม
 - 3.2.2 - อุณหภูมิ
 - 3.2.3 - ขั้นตอนการทำงาน
 - 3.2.4 - เวลา
 - 3.2.5 - ข้อผิดพลาด

คุณสมบัติทางเทคนิค

- 1. ภายในห้องล้างมีขนาดความจุของห้องล้าง 1200 ลิตร ทำด้วย Stainless Steel เกรด 316L
- 2. ภายในห้องล้างจะมีหัวฉีดสำหรับฉีดชำระล้างได้ อยู่ส่วนบนของห้องล้างประมาณ 80 ชุด โดยจะทำการ ล้างสายยาง ขนาดต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด และมีระบบล้างพื้นแบบหัวฉีดอยู่บริเวณด้านข้างของห้องล้างโดยทำความสะอาดแบบท่อพ่นผสมแรงดัน และสามารถล้างสายต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 120 เส้นต่อรอบ โดยรองรับสายยางที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. และจะมีหัวฉีดระบบล้าง ทำความสะอาดแบบหัวฉีดทำด้วย Stainless Steel อยู่ด้านข้างของห้องล้าง
- 3. มีถังใส่น้ำยาล้างและน้ำยาที่ช่วยในการอบแห้ง เพื่อทำให้แห้งเร็ว พร้อมปั้มน้ำยาจำนวน 1 ตัว ปั้มน้ำหมุนเวียน (Circulation Pump) จำนวน 1 ตัว ปั้มเพื่อระบายน้ำทิ้ง (Vertical Drain Pump) จำนวน 1 ตัว โดยติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง
 - ก่อนทำการล้างจะมีโปรแกรมตรวจสอบปริมาณน้ำก่อนการล้างทุกครั้ง หลังจากทำการล้างเสร็จสิ้น
 - มีการอบแห้งภายในรอบเดียวกัน และมีระบบล้างทำความสะอาดลิ้นสปริงในห้องล้าง โดยอัตโนมัติหลังเสร็จสิ้นการล้าง
 - มีระบบตรวจสอบอุณหภูมิในห้องล้าง (Double Temperature Checked) เพื่อป้องกันการผิดพลาดของอุณหภูมิ
 - ตัวเครื่องจะมีเซฟตี้วาล์ว จำนวน 2 ตัว เพื่อป้องกันแรงดันในห้องล้างเกิน
- 4. ส่วนประกอบของเครื่อง ด้านนอกทั้งหมดทำด้วย Stainless Steel เกรด 304
 - มีระบบสายดิน ติดตั้งแยกออกจากระบบของอาคาร
- 5. หากมีข้อผิดพลาดหรือขัดข้อง เครื่องจะหยุดการทำงานและมีสัญญาณเตือนพร้อมระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง จะแสดง Fault Code บอกสาเหตุที่เครื่องทำงานผิดปกติบนจอ Display
- 6. ในตัวเครื่องจะมีระบบอ่านค่าความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ท่อน้ำ หากผิดปกติเครื่องจะไม่ทำงานและขณะเครื่องทำงานประตูจะล็อกอัตโนมัติ หากเกิดเหตุขัดข้องเครื่องจะหยุดและประตูจะคลายออกทำให้เปิดประตูได้



50 ชม 9/10/17

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ



เครื่องกรองน้ำ
 หรือระบบน้ำ RO

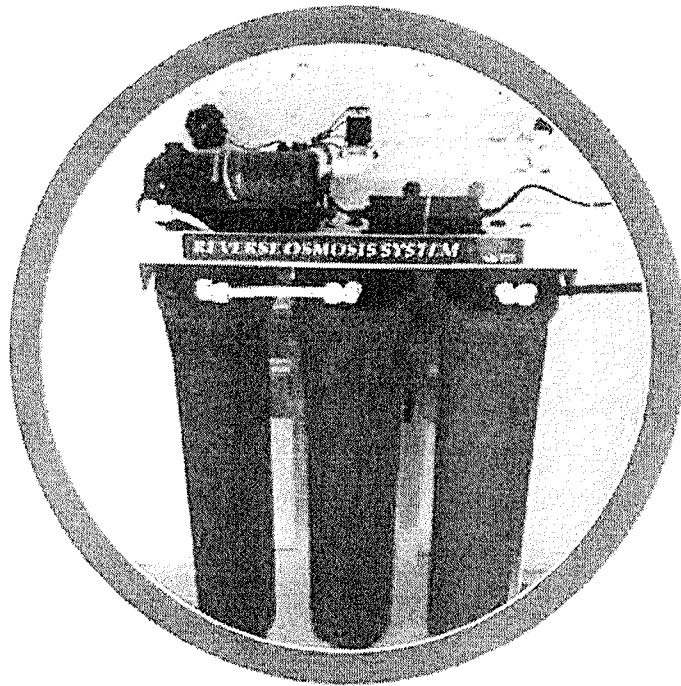

ธีรชน อภิวัฒน์ มรรณ
nam
 NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ^{ธีรชน อภิวัฒน์ มรรณ}
 ๑. ลงชื่อ..... V. m ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... ธีรชน อภิวัฒน์ กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... อน กรรมการ


nam
 NAMWIWAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

Product data sheet

deconex® PROZYME ALKA

Mildly alkaline/enzymatic instrument
cleaner

For instrument treatment in washer-disinfectors

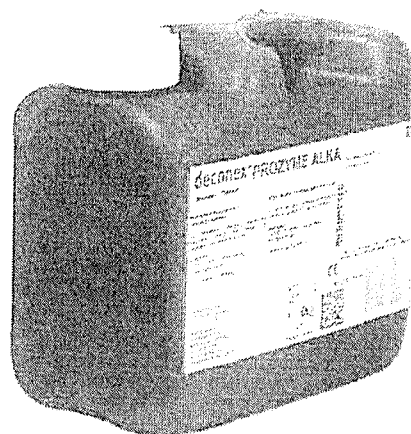

Ingredients

Surfactant substances
Enzymes (proteases)
Complexing agents
Solubilisers
Sequestering agents
Preservatives

Material compatibility

deconex® PROZYME ALKA is compatible with a wide range of materials.

Suitable for:

Stainless steel, aluminium, anodised aluminium, titanium, copper, brass, zinc, tin, chrome-plated materials, plastics, elastomers including polyurethane, silicone, teflon, rubber and latex, glass and ceramic materials. There is no known material incompatibility.

Appropriate compatibility tests should be performed for all materials not listed, or contact Borer Chemie AG if necessary.

Concentrate:

For compatibility with transport and peristaltic hoses, please request the separate information sheet.

CE marking

deconex® PROZYME ALKA meets the requirements for medical devices pursuant to the Medical Devices Directive 93/42/EEC.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....*Korn*.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....*นิพนธ์*.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....*อนัน*.....กรรมการ

บริษัท นาม จำกัด

nam[®]
NAMVIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท นาม จำกัด

nam[®]
NAMVIWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

borer

Advanced cleaning solutions

deconex® PROZYME ALKA

Physicochemical data

pH	1 % solution in deionised (DI) water	approx. 10.1
Density	Concentrate	1.09 g/mL
Appearance	Concentrate	clear, yellowish

Packaging

Containers, seals and labels are made from recyclable poly ethylene.

Additional information

Please read the instructions for use and the relevant safety data sheet before using this product.

Benefit from our know-how! Please contact us for practical information on your specific application.

Container sizes


Type of container	Container content
5 l canister	5 kg
10 l canister	10 kg
25 l canister	25 kg
220 l barrel	220 kg

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... *V. M. K.* ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... *Dr. K. K.* กรรมการ


๓. ลงชื่อ..... *one* กรรมการ

บริษัท นามวิวัฒน์ จำกัด

 NAMWIT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED



Manufacturer:
 Borer Chemie AG
 Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
 Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
 office@borer.ch, www.borer.ch

บริษัท นามวิวัฒน์ จำกัด
สำนักงาน สาขา ราชัย

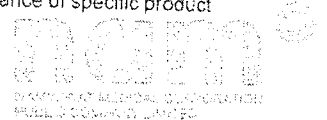All information provided is based on our comprehensive knowledge and does not constitute a legally binding assurance of specific product properties.


 NAMWIT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED


 borer
 Advanced cleaning solutions

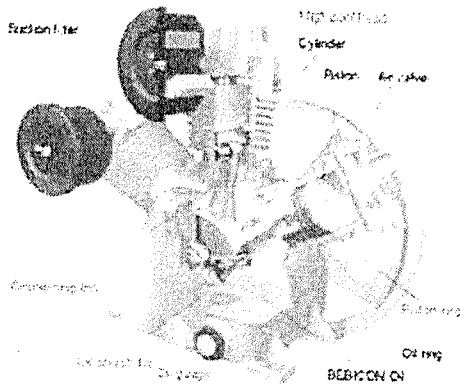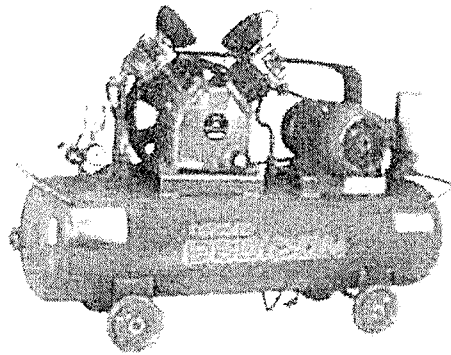

HITACHI BEBICON
 Model : 3.7P-9.5V3A

เป็นแบบ 5 แรงม้า 5 แรงม้า รุ่น : 3.7P-9.5V3A

Piston type . air cooling . 2 Cylinder

Working Pressure 1 - 9.5 Bar . (Kg/cm)

14.5 - 137.75 Psi

Piston displacement air delivery 541 U/min

Actual Air Delivery at 9.5 Bar 440 U/min

Motor "HITACHI" 5 HP/3.7 KW . 380 V

3 Phase . 50 Hz

Compressor Speed 1,000 r.p.m

Air Tank 170 Liter

Weight 140 Kg

Noise Level 74 dB(A)

เป็นแบบรถเข็น

ขนาดความดันระดับอากาศ 2 ลูกสูบ

ผลิตแรงดันระดับ 1 - 9.5 บาร์ (Kg/cm)

14.5 - 137.75 Psi (ปอนด์)

อัตราการไหลระดับอากาศ 541 ลิตร/นาที

ที่ 541 ลิตร/นาที

อัตราการไหลระดับที่แรงดันระดับ 9.5 บาร์

440 ลิตร/นาที

มอเตอร์ "ฮิตาชิ" ขนาด 5 แรงม้า/ 3.7 KW.

ไฟ 380 โวลต์ . 3 เฟส . 50 เฮิร์ต

ความเร็วรอบของมอเตอร์ 1,000 รอบ/นาที

ขนาดถังเก็บลม 170 ลิตร

น้ำหนัก 140 กิโลกรัม


ความดังเสียง 74 เดซิเบล

Specifications (HORIZONTAL & VERTICAL TANK MC)

Model	Capacity (L)	Working Pressure (Bar)	Max. Working Pressure (Bar)	Motor Power (KW)	Motor Speed (r.p.m)	Actual Air Delivery (U/min)	Piston Displacement (U/min)	Weight (Kg)	Noise Level (dB(A))
3.7P-9.5V3A	170	1-9.5	14.5	3.7	1000	440	541	140	74

ชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

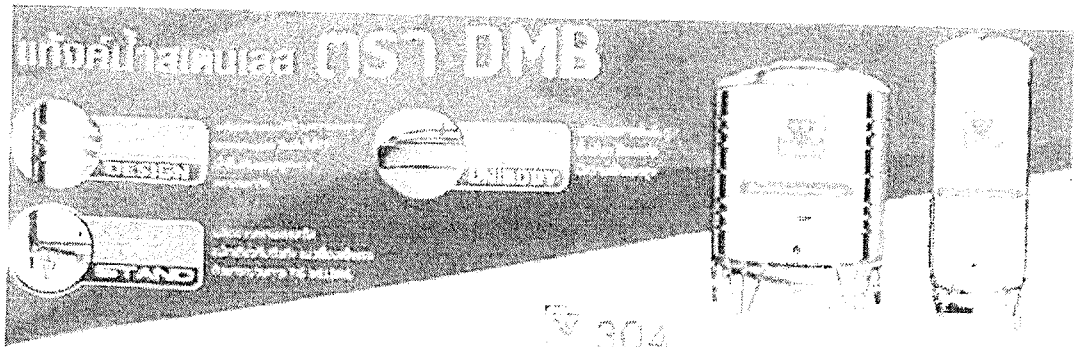

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์: DMB
 ประเภท: Disinfectant
 ขนาดบรรจุ: 500 ml
 วัตถุประสงค์: ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นผิว

ข้อมูลการนำเข้า

นำเข้าโดย: บริษัท นามวาท จำกัด
 ที่อยู่: 999/3-5 Moo 9 Pracha-Uthit-Kusong Rd., Naiklangbangplated, Phrasamat Chedi, Samutprakarn 10790 Thailand

ชัชวาล สุทธิพงษ์
nam[®]
 NAMWATT MEDICAL CORPORATION
 บริษัท นามวาท จำกัด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ.....*ชัชวาล สุทธิพงษ์*.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....*ดร. ชัยวัฒน์*.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....*ดร. ชัยวัฒน์*.....กรรมการ

nam[®]
 NAMWATT MEDICAL CORPORATION
 บริษัท นามวาท จำกัด

5.1



ISO 9001

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Certificate of Approval

This is to certify that

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited

Address of premises : 999/3-5 Moo 9, Prachauthit-Khusang Road,
Naiklong Bangplakod, Prasamut Chedi District,
Samutprakarn 10290, Thailand

has been assessed and found to be conforming to the requirements of
TIS 9001-2559 (ISO 9001:2015)

for the scope :

1. Design, manufacture, installation, sale and service of large steam sterilizers, ethylene oxide sterilizers, washer disinfectors, ultrasonic washer, low temperature steam and formaldehyde sterilizers, hydrogen peroxide sterilizers and medical device dryer
2. Manufacture and sale of formaldehyde solutions and hydrogen peroxide solutions
3. Distribution of cleaning concentrates, disinfectants and accessories of medical devices
4. Distribution of chemical and biological indicators for sterilization processes of steam, ethylene oxide, formaldehyde, hydrogen peroxide, washer disinfectors, ultrasonic washer and dry heat
5. Sterilization of medical equipment service
6. Disinfection of infectious medical waste service

by
Management System Certification Institute (Thailand),
Foundation for Industrial Development

โดย อภิรักษ์

Jongrak Rojpalasatean

(Mr. Jongrak Rojpalasatean)

President

Management System Certification Institute (Thailand)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

Date of Issue

4th November 2022

Valid Until

11th May 2025

First issued Date

24th May 2019



สงขลาพรชัย



MASCI

TIS 9001-2559

5.1



ISO 13485
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR MEDICAL DEVICES

Certificate of Approval

This is to certify that

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited

Address of premises : 999/3-5 Moo 9, Prachauthi-Khusang Road,
Naiklong Bangplakod, Prasamut Chedi District,
Samutprakarn 10290, Thailand

has been assessed and found to be conforming to the requirements of
ISO 13485:2016 Quality Management System for Medical Devices

for the scope :

1. Design, manufacture, installation, sale and service of large steam sterilizers, ethylene oxide sterilizers, washer disinfectors, ultrasonic washer, low temperature steam and formaldehyde sterilizers, hydrogen peroxide sterilizers and medical device dryer
2. Manufacture and sale of formaldehyde solutions and hydrogen peroxide solutions
3. Distribution of cleaning concentrates, disinfectants and accessories of medical devices
4. Distribution of chemical and biological indicators for sterilization processes of steam, ethylene oxide, formaldehyde, hydrogen peroxide, washer disinfectors, ultrasonic washer and dry heat
5. Sterilization of medical equipment service
6. Disinfection of infectious medical waste service

Signature

by
Management System Certification Institute (Thailand)
Foundation for Industrial Development

Date of Issue 4th November 2022

Valid Until 11th May 2025

First Issued Date 28th June 2019

Signature of Mr. Jongrak Rojpatasatean

(Mr. Jongrak Rojpatasatean)

President

Management System Certification Institute (Thailand)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ



MASCI

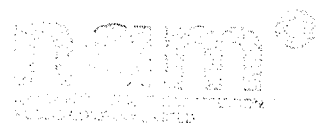

EG-Zertifikat / EC-Certificate

gem. 93/42/EWG Anhang II ohne (4) / acc. 93/42/EEC Annex II without (4)

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / This certifies, that the company

Namwiwat Engineering (1992) Co., Ltd.
999/5 Moo 9 Prachauthit-Khusang Rd., Tambol Naiklongbangplakod,
Amphur Pharsamutjeydee, Samutprakarn 10290
Thailand

für die Produkte / die Kategorie: Liste der Produkte siehe Anlage 1
for the products / product category: List of products see annex 1

Dampf-Groß-Sterilisatoren und Ethylenoxid-Sterilisatoren Large Steam Sterilizers and Ethylene Oxide Sterilizers

ein Qualitätssicherungssystem für die Auslegung, die Fertigung und die Endkontrolle der genannten Produkte nach Maßgabe des Anhang II (ohne Abschnitt 4) der Richtlinie 93/42/EWG anwendet. Zusätzlich zur CE-Kennzeichnung muss die Kennnummer der Benannten Stelle angebracht werden. Die Gültigkeit dieses Zertifikats beruht auf der Aufrechterhaltung des Qualitätssicherungssystems in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie und seiner Überwachung durch die Benannte Stelle gem. Anhang II Abschnitt 5. Das Zertifikat ist unter keinen Umständen übertragbar.

has established a quality system for design, production and final testing acc. to the requirements of Annex II (without section 4) of the directive 93/42/EEC. Additional to the CE-marking the notification number of the Notified Body has to be affixed. The validity of this certificate is based on the maintenance of the quality system in accordance with the requirements of the directive and its surveillance by the Notified Body according Annex II section 5. The certificate may not be transferred under any circumstances.

Reg.-Nr. / Reg.-No. 44 232 117371
Bericht Nr. / Report No. 3526 1530
3526 1531

Gültigkeit / Validity
von / from 2020-02-28
bis / until 2024-05-28
Edition 3



Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte
Certification body for medical devices

Essen, 2020-03-02



TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de

Benannte Stelle Kenn-Nr. 0044 / Notified Body ID. No. 0044



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
- ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
- ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

ผู้ซื้อ: สจล.ลาพรชัย





ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์

ใบจดทะเบียนที่ศผ. 148/2554

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมี นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้จดทะเบียน
สถานประกอบการของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ชื่อ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ 999/3-5

ตรอก/ซอย			ถนน	ประชาอุทิศ-คูสร้าง
หมู่ที่ 9	ตำบล/แขวง	ในคลองบางปลากด	อำเภอ/เขต	พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด	สมุทรปราการ	รหัสไปรษณีย์ 10290	โทรศัพท์	0 2461 7287

สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 999/3-5

ตรอก/ซอย			ถนน	ประชาอุทิศ-คูสร้าง
หมู่ที่ 9	ตำบล/แขวง	ในคลองบางปลากด	อำเภอ/เขต	พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด	สมุทรปราการ	รหัสไปรษณีย์ 10290	โทรศัพท์	0 2461 7287


สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่

ตรอก/ซอย			ถนน	
หมู่ที่	ตำบล/แขวง		อำเภอ/เขต	
จังหวัด		รหัสไปรษณีย์	โทรศัพท์	

สำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ (ตามเอกสารแนบท้าย)
โดยมีผู้ควบคุมการผลิตเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(7) ดังนี้
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
และให้ใช้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการนี้เท่านั้น


ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

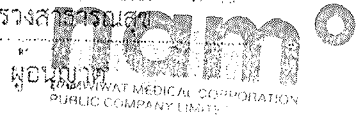

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ



การต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ

การต่ออายุครั้งที่ 1

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง
ผู้อนุญาต

การต่ออายุครั้งที่ 2

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง
ผู้อนุญาต

การต่ออายุครั้งที่ 3

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง
ผู้อนุญาต

การต่ออายุครั้งที่ 4

ให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
ตำแหน่ง
ผู้อนุญาต

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

nam[®]

NAMWATAY MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ



SO 2565/ 633

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

เรียน ประธานคณะกรรมการปี ดของสหประชาชาติ/ประกวดราคา

เรื่อง หนังสือรับรอง (ใบผ่านงาน)

ตามที่ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมยื่นซองของสหประชาชาติ/ประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดต่างๆ, เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนอีทกไซด์ 100%, เครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ, เครื่องเป่าแห้งอุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องอัลตราโซนิก, เครื่องล้างอุปกรณ์ท่อสายทางการแพทย์ขนาดต่างๆ และผู้เสนอราคาต้องมี หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องและต้องแสดงหลักฐานว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ ซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ โดยมีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซอง นั้น

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่าบริษัทฯ มีช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์ ได้ผ่านการ ฝึกอบรมการปฏิบัติงานการตรวจซ่อมบำรุงรักษาและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ | 2.นายฉลอง เพ็ชรชู | 3.นายคมสันต์ กั้นทะโสภ |
| 4.นายแสวง บุญธง | 5.นายทัศนีย์สันต์ ทองจำนงค์ | 6.นายจิรพงษ์ พักสิทธิ์ |
| 7.นายสุรศักดิ์ หาญจิรชัยนง | 8.นายวิทวัส วงศ์จักร | 9.นายมนชัย ว่องเอี่ยมพันธ์ุ |
| 10.นายกิจเดช นิยมทรัพย์ | 11.นายอภิรักษ์ ไชยวงศ์ | 12.นายไพศาล ฉาวรบรรจบ |
| 13.นายชัยมงคล กุลมิตร | 14.นายสุริยา ทองคำ | 15.นายเกียรติศักดิ์ นาชีวา |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

ขอแสดงความคิดเห็นลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

nam
 NAMWIVAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED

nam
 NAMWIVAT MEDICAL CORPORATION
 PUBLIC COMPANY LIMITED


nam

Namwatt Medical Corporation Public Company Limited (มหาชน) (นาม) (Co.)
999/3-5 Moo 9 Phatongvit Sukkong Rd., Nakhonbangkok Rd.
Phrasongkhro Cherd, Samutprakarn 10290 Thailand
+66 2461 7287-90 +66 2461 7291
TAX ID : 0107565000554 www.namwatt.com

หนังสือแสดงการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย

ขอรับรองว่า บริษัท นามวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 999/3-5 หมู่ที่ 9 ถนน
ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ผลิตและ
จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ดังต่อไปนี้ คือ เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสูญญากาศอัตโนมัติ, เครื่องอบฆ่าเชื้อ
ด้วยแก๊สเอทริลีนออกไซด์ 100% , เครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, เครื่องอบฆ่าเชื้อ
อัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ 2% , เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ, เครื่องล้างอุปกรณ์ท่อสาวยางทาง
การแพทย์, เครื่องล้างอัลตราโซนิค และเครื่องเป่าแห้งอุปกรณ์ทางการแพทย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ




ขอแสดงความนับถือ

(นายวีโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นามวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศุภจิตา สุวณิชกุล

nam^o
NAMWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ๑. ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 - ๒. ลงชื่อ.....  กรรมการ
 - ๓. ลงชื่อ.....  กรรมการ

nam^o
NAMWAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

nam^o

Namwivat Medical Corporation Public Company Limited (Head Office)
9/99/3-5 Moo 9 Prachasrihik-Kusong Rd., Nakhonkguangpladod,
Phrasomul Chedi, Samutprakorn 10290 Thailand
t +66 2461 7287-93 f +66 2461 7201
TAX ID : 0107668030654 | www.namwivat.com

รายการเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (มีรายละเอียด)
开列往来账户对账单 (附明细) K-DEPOSIT STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT (WITH DETAIL)

ที่ DO.047 : N221028112800440318740/2655

หน้าที่ 1/9 (0962)

ชื่อบัญชี นมช. บำรุงสุขภาพ เมดิคัล คอร์ปอเรชั่น

999/3-5 ม.9 อ.ประจักษ์ศิลปาคม ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 10290

สาขาเงินฝาก

สาขา

บัญชีเงินฝาก

สกุลเงิน

สาขาเงินฝาก

สาขาเงินฝาก

662-1-00087-5

THB

ใช้สำหรับประกอบเอกสารมอบอำนาจเพื่อทำการลงนามในสัญญา
ณ โรงพยาบาลนครปฐม เท่านั้น

สำเนาถูกต้อง

nam^o

วิมล ๑๗/๑๗/๒๕๖๓

nam^o
NAMWIVAT MEDICAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED